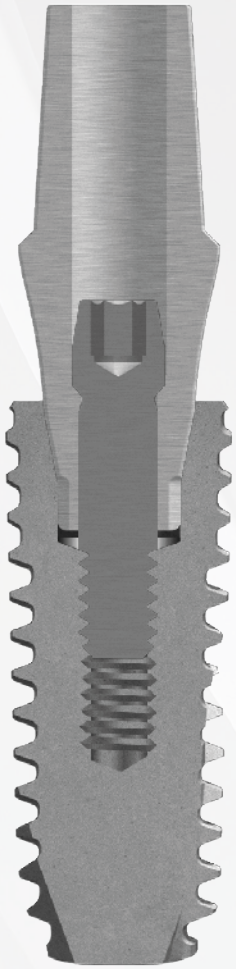
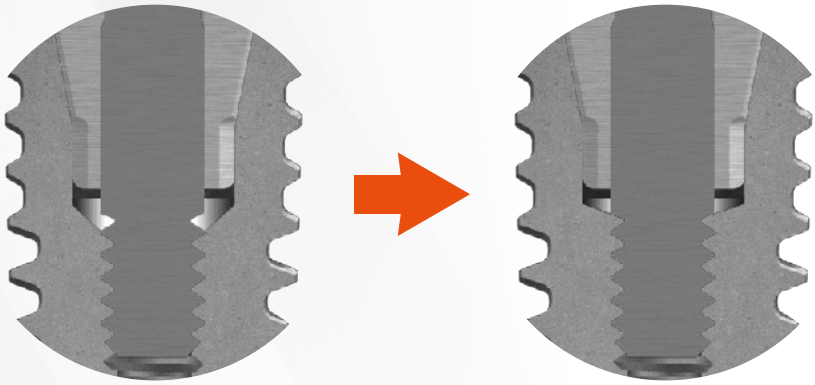
Прайс-лист Osstem Implant

Версия 03/2026



2026

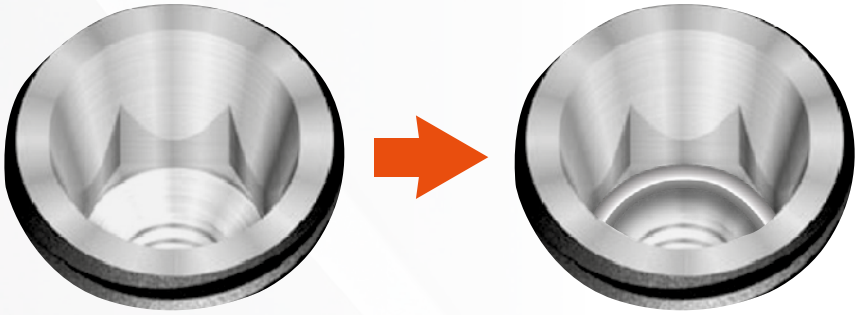




ИМПЛАНТАТЫ TS ДО ОБНОВЛЕНИЯ

- Абатмент не доходит до нижней части шестигранника внутри имплантата и создает компрессию. Нагрузка от винта тянет абатмент вниз, что может привести к «проседанию» абатмента в имплантате и создать дополнительное давление на шейку имплантата.
- Поскольку имплантат подвержен не только осевым, но и продольным нагрузкам – проседание абатмента и дополнительное напряжение в конусе, в совокупности с другими факторами может привести к поломке конструкции в будущем.





ИМПЛАНТАТЫ TS ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Для устранения пустот в области технического зазора (0.3 мм), в имплантат добавляется кольцо в нижней части внутреннего шестигранника

- Кольцо под шестигранником устраняет возможность сильной просадки абатмента и удерживает его в стабильном положении, также помогает в распределении нагрузки со стороны винта.

Содержание


TS система	Имплантат **TS SA**	4
	Имплантат **TS CA**	5
	Имплантат **TS SOI**	6
	Имплантат **Hiossen** Формирователь десны	7
	Винт **Ebony Gold** Лабораторный аналог Слепочный модуль для открытой ложки Слепочный модуль для закрытой ложки	8
	Лабораторный винт Абатмент **Transfer**	9
	Абатмент обтачиваемый **FreeForm ST** Абатмент угловой **Angled**	10
	Абатмент временный титановый Абатмент пластиковый для немедленной нагрузки Абатмент **Gold-Cast**	11
	Абатмент **NP-Cast** Абатмент шариковый **Stud**	12
	Абатмент **Port**	13
	Абатмент комбинированный **Convertible**	14
	Абатмент **Multi** прямой Абатмент **Multi Angled** угловой Титановые основания **Multi Ti Base**	15
	Абатмент **TS Link для Cerec**	16
	Абатмент **Pre-Milled** Абатмент **TS Link** универсальный Цифровой лабораторный аналог Скан Боди	17
SS система	Имплантат **SS III SA** Абатмент **SS Link** Абатмент **SS Pre-Milled**	18
	Слепочные модули **ComOcta**	19
	Абатмент **ComOcta** Абатмент **ComOcta Angled** угловой Абатмент **Octa**	20
	Компоненты абатмента **Octa**	21
OS система	Ортодонтические винты	22
MS система	Имплантат **MS** и компоненты	24
HKP материалы	Мембрана титановая **OssBuilder OB2, OB3**	25
	Пины и винты костные	26
	Компоненты мембраны титановой **OssBuilder** Ручная отвертка Машинная отвертка	27
	Костные материалы **A-Oss, SureOss, OsteOss**	28
	Мембрана коллагеновая **Ossguide, Ossmem** Бесклеточный дермальный матрикс **Surederm**	29
	А-силиконовый слепочный материал **HySil** (база)	29
Хирург. наборы	Хирургические наборы	30
	Наборы инструментов	33
Инструменты	Сверло-трепан Контурный бор Мукотом	34
	Сверло для забора аутокости	35
	Инструменты набора **122 Kit**	36
	Инструменты набора **Prosthetic Kit**	39
	Инструменты набора **One Guide Kit**	41
Оборудование	Стоматологическая установка **K3**	44
	Стоматологическая установка **K5**	46
	Компьютерный томограф **T2 Plus**	48
	Физиодиспенсеры **Surgic PRO 2 OPT, Surgic PRO, SM5**	50
	Интраоральный сканер **Medit i700**	
Уход за полостью рта	Ирригаторы Зубные щетки	51
	Зубные пасты	52
	Средства для ухода за полостью рта	53
Центр обучения OIC		54

TS система

M Мини R Стандарт

Имплантат TS III SA

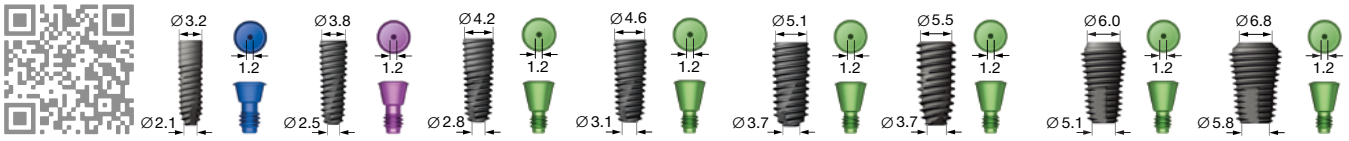TS III SA Ultra-Wide



Диаметр / Длина	Мини		Стандарт				Стандарт	
	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код		Код				Код	
4 мм	–	–	–	–	BTS3S5004S*	–	–	–
5 мм	–	–	–	–	BTS3S5005S**	–	–	–
6 мм	–	–	BTS3S4006S***	BTS3S4506S***	BTS3S5006S	BTS3S5506S	BTS3S6006S	BTS3S7006S
7 мм	–	–	BTS3S4007S	BTS3S4507S	BTS3S5007S	BTS3S5507S	BTS3S6007S	BTS3S7007S
8.5 мм	BTS3M3008S	BTS3M3508S	BTS3S4008S	BTS3S4508S	BTS3S5008S	BTS3S5508S	BTS3S6008S	BTS3S7008S
10 мм	BTS3M3010S	BTS3M3510S	BTS3S4010S	BTS3S4510S	BTS3S5010S	BTS3S5510S	BTS3S6010S	BTS3S7010S
11.5 мм	BTS3M3011S	BTS3M3511S	BTS3S4011S	BTS3S4511S	BTS3S5011S	BTS3S5511S	BTS3S6011S	BTS3S7011S
13 мм	BTS3M3013S	BTS3M3513S	BTS3S4013S	BTS3S4513S	BTS3S5013S	BTS3S5513S	BTS3S6013S	BTS3S7013S
15 мм	–	BTS3M3515S	BTS3S4015S	BTS3S4515S	BTS3S5015S	BTS3S5515S	–	–
18 мм	–	BTS3M3518S	BTS3S4018S	BTS3S4518S	BTS3S5018S	–	–	–

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

*погружная часть – 4 мм | (фактическая длина – 6 мм)
**погружная часть – 5 мм | (фактическая длина – 6 мм)
***погружная часть – 6 мм | (фактическая длина – 7 мм)

Имплантат TS IV SA

TS IV SA Ultra-Wide




Диаметр / Длина	Стандарт			Стандарт	
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код			Код	
7 мм	BTS4S4007S	BTS4S4507S	BTS4S5007S	BTS4S6007S	BTS4S7007S*
8.5 мм	BTS4S4008S	BTS4S4508S	BTS4S5008S	BTS4S6008S	BTS4S7008S*
10 мм	BTS4S4010S	BTS4S4510S	BTS4S5010S	BTS4S6010S	BTS4S7010S*
11.5 мм	BTS4S4011S	BTS4S4511S	BTS4S5011S	BTS4S6011S	BTS4S7011S*
13 мм	BTS4S4013S	BTS4S4513S	BTS4S5013S	BTS4S6013S	BTS4S7013S*

*Под заказ

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

Имплантат TS III CA в кальциевом растворе

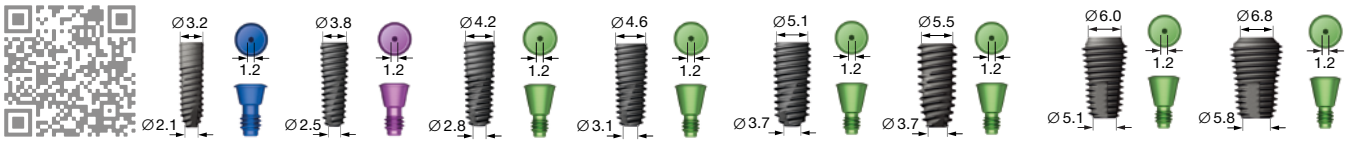TS III CA Ultra-Wide



Диаметр / Длина	Мини		Стандарт				Стандарт	
	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код		Код				Код	
4 мм	–	–	–	–	BTS3S5004C*	–	–	–
5 мм	–	–	–	–	BTS3S5005C**	–	–	–
6 мм	–	–	BTS3S4006C***	BTS3S4506C***	BTS3S5006C	BTS3S5506C	BTS3S6006C	BTS3S7006C
7 мм	–	–	BTS3S4007C	BTS3S4507C	BTS3S5007C	BTS3S5507C	BTS3S6007C	BTS3S7007C
8.5 мм	BTS3M3008C	BTS3M3508C	BTS3S4008C	BTS3S4508C	BTS3S5008C	BTS3S5508C	BTS3S6008C	BTS3S7008C
10 мм	BTS3M3010C	BTS3M3510C	BTS3S4010C	BTS3S4510C	BTS3S5010C	BTS3S5510C	BTS3S6010C	BTS3S7010C
11.5 мм	BTS3M3011C	BTS3M3511C	BTS3S4011C	BTS3S4511C	BTS3S5011C	BTS3S5511C	BTS3S6011C	BTS3S7011C
13 мм	BTS3M3013C	BTS3M3513C	BTS3S4013C	BTS3S4513C	BTS3S5013C	BTS3S5513C	BTS3S6013C	BTS3S7013C
15 мм	–	BTS3M3515C	BTS3S4015C	BTS3S4515C	BTS3S5015C	BTS3S5515C	–	–
18 мм	–	BTS3M3518C	BTS3S4018C	BTS3S4518C	BTS3S5018C	–	–	–

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

*погружная часть – 4 мм | (фактическая длина – 6 мм)
**погружная часть – 5 мм | (фактическая длина – 6 мм)
***погружная часть – 6 мм | (фактическая длина – 7 мм)

Имплантат TS IV CA в кальциевом растворе Ultra-Wide



Диаметр / Длина	Стандарт	
	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код	
7 мм	BTS4S6007C*	BTS4S7007C*
8.5 мм	BTS4S6008C*	BTS4S7008C*
10 мм	BTS4S6010C*	BTS4S7010C*
11.5 мм	BTS4S6011C*	BTS4S7011C*
13 мм	BTS4S6013C*	BTS4S7013C*
	*Под заказ	*Под заказ

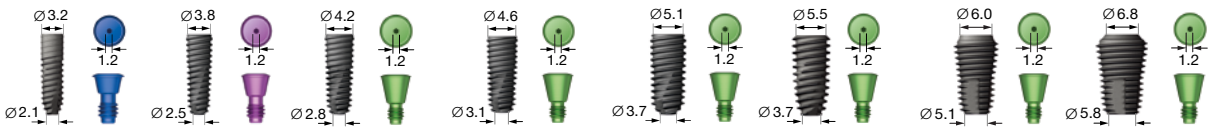
Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

TS система

M Мини R Стандарт

Имплантат TS III SOI

TS III SOI Ultra-Wide




Диаметр / Длина	Мини		Стандарт				Стандарт	
	Ø 3.0	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код		Код				Код	
4 мм	–	–	–	–	BTS3S5004A*	–	–	–
5 мм	–	–	–	–	BTS3S5005A**	–	–	–
6 мм	–	–	BTS3S4006A***	BTS3S4506A***	BTS3S5006A	BTS3S5506A	BTS3S6006A	BTS3S7006A
7 мм	–	–	BTS3S4007A	BTS3S4507A	BTS3S5007A	BTS3S5507A	BTS3S6007A	BTS3S7007A
8.5 мм	BTS3M3008A	BTS3M3508A	BTS3S4008A	BTS3S4508A	BTS3S5008A	BTS3S5508A	BTS3S6008A	BTS3S7008A
10 мм	BTS3M3010A	BTS3M3510A	BTS3S4010A	BTS3S4510A	BTS3S5010A	BTS3S5510A	BTS3S6010A	BTS3S7010A
11.5 мм	BTS3M3011A	BTS3M3511A	BTS3S4011A	BTS3S4511A	BTS3S5011A	BTS3S5511A	BTS3S6011A	BTS3S7011A
13 мм	BTS3M3013A	BTS3M3513A	BTS3S4013A	BTS3S4513A	BTS3S5013A	BTS3S5513A	BTS3S6013A	BTS3S7013A
15 мм	–	BTS3M3515A	BTS3S4015A	BTS3S4515A	BTS3S5015A	–	–	–
18 мм	–	BTS3M3518A	BTS3S4018A	BTS3S4518A	BTS3S5018A	–	–	–

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

*погружная часть – 4 мм | (фактическая длина – 6 мм)
**погружная часть – 5 мм | (фактическая длина – 6 мм)
***погружная часть – 6 мм | (фактическая длина – 7 мм)

Имплантат TS III SOI (без адаптера)

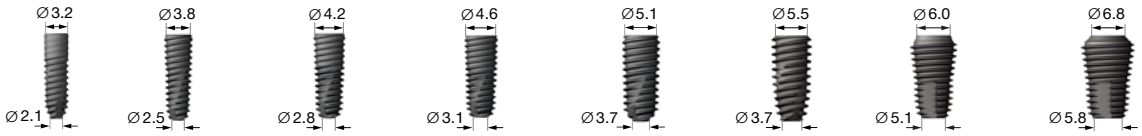TS III SOI Ultra-Wide



Диаметр / Длина	Мини		Стандарт				Стандарт	
		Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код		Код				Код	
4 мм	–	–	–	–	TS3S5004A*	–	–	–
5 мм	–	–	–	–	TS3S5005A**	–	–	–
6 мм	–	–	TS3S4006A***	TS3S4506A***	TS3S5006A	TS3S5506A	TS3S6006A	TS3S7006A
7 мм	–	–	TS3S4007A	TS3S4507A	TS3S5007A	TS3S5507A	TS3S6007A	TS3S7007A
8.5 мм	TS3M3008A	TS3M3508A	TS3S4008A	TS3S4508A	TS3S5008A	TS3S5508A	TS3S6008A	TS3S7008A
10 мм	TS3M3010A	TS3M3510A	TS3S4010A	TS3S4510A	TS3S5010A	TS3S5510A	TS3S6010A	TS3S7010A
11.5 мм	TS3M3011A	TS3M3511A	TS3S4011A	TS3S4511A	TS3S5011A	TS3S5511A	TS3S6011A	TS3S7011A
13 мм	TS3M3013A	TS3M3513A	TS3S4013A	TS3S4513A	TS3S5013A	TS3S5513A	TS3S6013A	TS3S7013A
15 мм	–	TS3M3515A	TS3S4015A	TS3S4515A	TS3S5015A	–	–	–
18 мм	–	TS3M3518A	TS3S4018A	TS3S4518A	TS3S5018A	–	–	–

Комплектация: Имплантат.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

*погружная часть – 4 мм | (фактическая длина – 6 мм)
**погружная часть – 5 мм | (фактическая длина – 6 мм)
***погружная часть – 6 мм | (фактическая длина – 7 мм)


Имплантат Hiossen ET III SA с адаптером



Диаметр / Длина	Мини	Стандарт		
	Ø 3.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0
	Код	Код		
7 мм	–	AET3R4007S	AET3R4507S	AET3R5007S
8.5 мм	AET3M3508S	AET3R4008S	AET3R4508S	AET3R5008S
10 мм	AET3M3510S	AET3R4010S	AET3R4510S	AET3R5010S
11.5 мм	AET3M3511S	AET3R4011S	AET3R4511S	AET3R5011S
13 мм	AET3M3513S	AET3R4013S	AET3R4513S	AET3R5013S
15 мм	AET3M3515S	AET3R4015S	AET3R4515S	AET3R5015S

Комплектация: Имплантат + Адаптер + Заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент - не более 40 Нсм

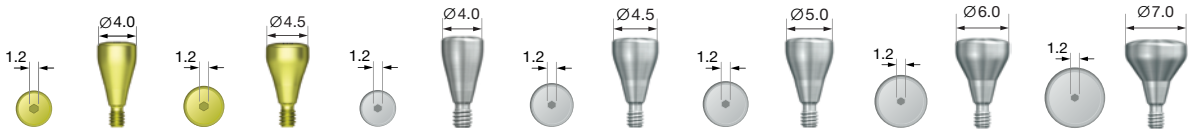Формирователь десны для системы имплантатов TS



Диаметр / Длина	Мини		Стандарт				
	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код		Код				
3 мм	TSHA403M	TSHA453M	TSHA403R	TSHA453R	TSHA503R	TSHA603R	TSHA703R
4 мм	TSHA404M	TSHA454M	TSHA404R	TSHA454R	TSHA504R	TSHA604R	TSHA704R
5 мм	TSHA405M	TSHA455M	TSHA405R	TSHA455R	TSHA505R	TSHA605R	TSHA705R
7 мм	TSHA407M	TSHA457M	TSHA407R	TSHA457R	TSHA507R	TSHA607R	TSHA707R
9 мм	TSHA409M	TSHA459M	TSHA409R	TSHA459R	TSHA509R	TSHA609R	TSHA709R

Рекомендуемый крутящий момент - не более 10 Нсм

TS система

M Мини R Стандарт

Винт Ebony Gold



Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSM	GSABSS

Лабораторный аналог



Мини		Стандарт
Код ∅ 3.0	Код ∅ 3.5	Код
GSTLA300	GSTLA350	GSTLA400

Рекомендуемый крутящий момент:
- Мини – не более 20 Нсм
- Стандарт – не более 30 Нсм

Слепочный модуль для открытой ложки



Диаметр / Длина	Мини	Стандарт		
	∅ 4.0	∅ 4.0	∅ 5.0	∅ 6.0
	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
11 мм	GSPIM4011	GSPIS4011	GSPIS5011	GSPIS6011
15 мм	GSPIM4015	GSPIS4015	GSPIS5015	GSPIS6015

*Для не 6-гран.: код+N
Рекомендуемый крутящий момент: не более 40 Нсм

Слепочный модуль для закрытой ложки



Диаметр / Длина	Мини	Стандарт		
	∅ 4.0	∅ 4.0	∅ 5.0	∅ 6.0
	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
11 мм	GSTIM4011	GSTIS4011	GSTIS5011	GSTIS6011
14 мм	GSTIM4014	GSTIS4014	GSTIS5014	GSTIS6014

*Для не 6-гран.: код+N
Рекомендуемый крутящий момент: не более 40 Нсм

Лабораторный винт






Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSML	GSABSSL

Длинный винт





Мини	Стандарт
Код	Код
GSABSMW	GSABSSW

Используется для фиксации готовых коронок
и восковых моделей в условиях лаборатории.
Не является компонентом слепочного модуля

Абатмент прямой Transfer



Высота	Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт		
		Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
		Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
4 мм	1 мм	–	–	GSTA5410WH	GSTA6410WH
	2 мм	–	–	GSTA5420WH	GSTA6420WH
	3 мм	–	–	GSTA5430WH	GSTA6430WH
	4 мм	–	–	GSTA5440WH	GSTA6440WH
	5 мм	–	–	GSTA5450WH	GSTA6450WH
5.5 мм	1 мм	GSTA4611WH	GSTAS4611WH	GSTA5610WH	GSTA6610WH
	2 мм	GSTA4621WH	GSTAS4621WH	GSTA5620WH	GSTA6620WH
	3 мм	GSTA4631WH	GSTAS4631WH	GSTA5630WH	GSTA6630WH
	4 мм	GSTA4641WH	GSTAS4641WH	GSTA5640WH	GSTA6640WH
	5 мм	GSTA4651WH	GSTAS4651WH	GSTA5650WH	GSTA6650WH
7 мм	1 мм	GSTA4711WH	GSTAS4711WH	GSTA5710WH	GSTA6710WH
	2 мм	GSTA4721WH	GSTAS4721WH	GSTA5720WH	GSTA6720WH
	3 мм	GSTA4731WH	GSTAS4731WH	GSTA5730WH	GSTA6730WH
	4 мм	GSTA4741WH	GSTAS4741WH	GSTA5740WH	GSTA6740WH
	5 мм	GSTA4751WH	GSTAS4751WH	GSTA5750WH	GSTA6750WH

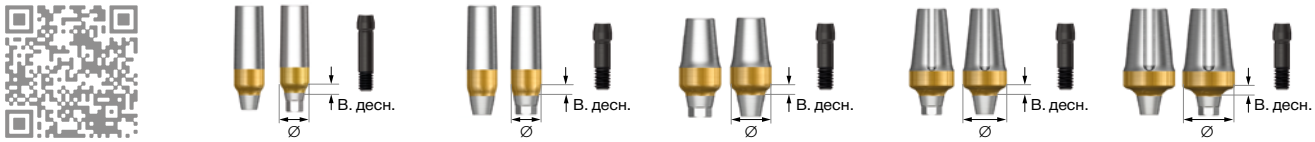
Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент:
- Мини – не более 20 Нсм
- Стандарт – не более 30 Нсм

*Для не 6-гран. WH заменить на NWH

TS система

M Мини R Стандарт

Абатмент обтачиваемый FreeForm ST



Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт			
	Ø 4.0	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.0	Ø 7.0
	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*			
1.5 мм	GSFAM4015WH	GSFA4015WH	GSFA5015WH	GSFA6015WH	GSFA7015WH
3 мм	GSFAM4030WH	GSFA4030WH	GSFA5030WH	GSFA6030WH	GSFA7030WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 20 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм

*Для не 6-гран.:
WH заменить на NWH

Абатмент угловой Angled



Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт		
	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 6.0
	Код 6-гран.*	Код 6-гран.*		
2 мм	GSAA4520MAWH	GSAA4520AWH	GSAA5020AWH	GSAA6020AWH
	GSAA4520MBWH	GSAA4520BWH	GSAA5020BWH	GSAA6020BWH
4 мм	GSAA4540MAWH	GSAA4540AWH	GSAA5040AWH	GSAA6040AWH
	GSAA4540MBWH	GSAA4540BWH	GSAA5040BWH	GSAA6040BWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 20 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм


*Для не 6-гран.: AWH/BWH
заменить на NWH


Селектор абатмента углового



Высота десны \ Диаметр	Мини	Стандарт	
	Ø 4.3	Ø 4.5	Ø 5.5
	Код	Код	
2 мм	GSAAS4320A	GSAAS4520A	GSAAS5520A
	GSAAS4320B	GSAAS4520B	GSAAS5520B
4 мм	GSAAS4340A	GSAAS4540A	GSAAS5540A
	GSAAS4340B	GSAAS4540B	GSAAS5540B

Абатмент временный титановый







Диаметр / Высота десны	Мини Ø 4.0		Стандарт Ø 4.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSTTA4010TH	GSTTA4010NTH	GSTTA4510TH	GSTTA4510NTH
3 мм	GSTTA4030TH	GSTTA4030NTH	GSTTA4530TH	GSTTA4530NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 20 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент временный пластиковый для немедленной нагрузки







Диаметр / Высота десны	Мини Ø 4.5		Стандарт Ø 5.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
5 мм	TSQTA4550TH	TSQTA4550NTH	TSQTA5550TH	TSQTA5550NTH

Комплектация: Абатмент + Специальный титановый винт.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 20 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент отливаемый Gold-Cast





Диаметр / Высота десны	Мини Ø 4.0		Стандарт Ø 4.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSGA4010SWH	GSGA4010BWH	GSGA4510SWH	GSGA4510BWH
3 мм	GSGA4030SWH	GSGA4030BWH	GSGA4530SWH	GSGA4530BWH

Состав: Au-Pt-Pd. Температура плавления от 1400° до 1450°
Комплектация: Абатмент+ Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 20 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм

TS система

M Мини R Стандарт

Абатмент отливаемый NP-Cast





Диаметр / Высота десны	Мини Ø 4.0		Стандарт Ø 4.5	
	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
1 мм	GSNA4010SWH	GSNA4010BWH	GSNA4510SWH	GSNA4510BWH
3 мм	GSNA4030SWH	GSNA4030BWH	GSNA4530SWH	GSNA4530BWH

Состав: Co-Cr-Mo. Температура плавления до 1550°.
Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 20 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм

Абатмент шариковый Stud






Диаметр / Высота десны	Мини Ø 3.5	Стандарт Ø 3.5
	Код	Код
1 мм	GSSAM3510	GSSA3510
2 мм	GSSAM3520	GSSA3520
3 мм	GSSAM3530	GSSA3530
4 мм	GSSAM3540	GSSA3540
5 мм	GSSAM3550	GSSA3550
6 мм	GSSAM3560	GSSA3560


Комплектация: Абатмент.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 30 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм
Фиксируется ключом AORD

Компоненты абатмента Stud

	Название	Код
	**Комплект ретенционных колпачков O-ring** (ретенционный колпачок O-ring - 1 шт., кольцо O-ring - 1 шт.)	RCS01
	**Комплект ретейнеров O-ring** (ретейнер O-ring - 1 шт., кольцо O-ring - 1 шт.)	RS01
	**Кольца O-ring, 5 шт**	OAON01S
	**Лабораторный аналог O-ring**	OAL
	**Ключ для абатмента O-ring** Используется для абатментов Stud, Convertible Ø 4.0	AORD

Абатмент Port







Диаметр / Высота десны	Мини	Стандарт
	Ø 3.7	Ø 3.7
	Код	Код
1 мм	TSPTA3510M	TSPTA4010R
2 мм	TSPTA3520M	TSPTA4020R
3 мм	TSPTA3530M	TSPTA4030R
4 мм	TSPTA3540M	TSPTA4040R
5 мм	TSPTA3550M	TSPTA4050R
6 мм	TSPTA3560M	TSPTA4060R

Комплектация: Абатмент.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 30 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм
Фиксируется ключом TWLDSK, TWLDLK


Компоненты абатмента Port


	Название	Код
	**Колпачок протеза, изолирующее кольцо, сменные ретенционные колпачки Port** по 1 шт. в комплекте	PTCMK
	**Комплект чёрных лабораторных колпачков Port, 4 шт.**	PTCPMS
	**Комплект ретенционных колпачков Port, 4 H, 4 шт.**	PTCM04S
	**Комплект ретенционных колпачков Port, 6 H, 4 шт.**	PTCM06S
	**Комплект ретенционных колпачков Port, 12 H, 4 шт.**	PTCM12S
	**Комплект ретенционных колпачков Port, 22 H, 4 шт.**	PTCM22S
	**Комплект ретенционных колпачков Port, 6 H, 4 шт.** с расширенным диапазоном	PTCEM06S
	**Комплект ретенционных колпачков Port, 12 H, 4 шт.** с расширенным диапазоном	PTCEM12S
	**Колпачок для матриц Port**	PTCMC *Под заказ
	**Комплект изолирующих колец Port, 20 шт**	PTCSS
	**Слепочный модуль Port**	PTCIC
	**Комплект лабораторных аналогов Port, 2 шт.**	PTCLA40S
	**Стержневой инструмент Port** используется для фиксации абатментов Port и ретенционных колпачков Port	PTCMT
	**Ключ для абатмента Port длинный**	TWLDLK
	**Ключ для абатмента Port короткий**	TWLDSK


TS система


M Мини R Стандарт

Абатмент комбинированный Convertible









Диаметр / Высота десны	Мини	Стандарт		
	Ø 4.0 | 6-гран.	Ø 4.0 | 6-гран.	Ø 5.0 | 8-гран.	Ø 6.0 | 8-гран.
	Код	Код	Код	Код
1 мм	GSCA4010P	GSCAS4010P	GSCA5010P	GSCA6010P
2 мм	GSCA4020P	GSCAS4020P	GSCA5020P	GSCA6020P
3 мм	GSCA4030P	GSCAS4030P	GSCA5030P	GSCA6030P
4 мм	GSCA4040P	GSCAS4040P	GSCA5040P	GSCA6040P
5 мм	–	–	GSCA5050P	GSCA6050P

Комплектация: Абатмент + Держатель.
Рекомендуемый крутящий момент: Мини | Стандарт – не более 30 Нсм


Компоненты абатмента Convertible


	Для Ø 4.0 | 6-гран.	Для Ø 4.0 | 6-гран.	Для Ø 5.0 | 8-гран.	Для Ø 6.0 | 8-гран.
Цилиндр Convertible Комбинированный + Мини-винт Ebony Gold	GSCC4070WH*	GSCC4070WH*	GSCC5070WH	GSCC6070WH
Цилиндр угловой Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GS17CC4080WH*	GS17CC4080WH*	GS17CC5080WH	GS17CC6080WH
Цилиндр Goldcast Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSGC400WH*	GSGC400WH*	GSGC500WH	GSGC600WH
Цилиндр временный Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSCTC400TTH*	GSCTC400TTH*	GSCTC500TTH	GSCTC600TTH
Цилиндр пластиковый Convertible + Мини-винт Ebony Gold	GSCPL400WH*	GSCPL400WH*	GSCPL500WH	GSCPL600WH
Винт Ebony Gold Convertible абатмента	GSFSM	GSFSM	GSFSR	GSFSR
Слепочный модуль Convertible для открытой ложки	GSPIC400	GSPIC400	GSPIC500	GSPIC600
Слепочный модуль Convertible для закрытой ложки	GSTIC400	GSTIC400	GSTIC500	GSTIC600
Защитный колпачок Convertible	GSCHC400WH	GSCHC400WH	GSCHC500WH	GSCHC600WH
Лабораторный аналог Convertible	GSCLA400	GSCLA400	GSCLA500	GSCLA600

Рекомендуемый крутящий момент для цилиндров Convertible – не более 15 Нсм
Ø 4.0 фиксируется ключом AORD (стр. 12) | Ø 5.0, Ø 6.0, фисируется ключом ODSS, ODSL (стр. 21)

*Для не 6-гран.: WH заменить на NWH

Абатмент Multi прямой





Диаметр / Высота десны	Мини	Стандарт
	Ø 4.8	Ø 4.8
	Код	Код
1 мм	TSMA5010MP	TSMA5010P
2 мм	TSMA5020MP	TSMA5020P
3 мм	TSMA5030MP	TSMA5030P
4 мм	TSMA5040MP	TSMA5040P
5 мм	TSMA5050MP	TSMA5050P

Комплектация: Абатмент + Пластиковый держатель.
Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини – не более 30 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм
Устанавливается: ручной отверткой MAOD / отверткой для физиодиспенсера MAMD


Абатмент Multi Angled угловой



Диаметр / Высота десны	Мини		Стандарт	
	17°	30°	17°	30°
	Ø 4.8		Ø 4.8	
	Код		Код	
2.5 мм	GS17MAM4820WH	–	GS17MAS4820WH	–
3 мм	GS17MAM4830WH	–	GS17MAS4830WH	–
3.5 мм	–	GS30MAM4830WH	–	GS30MAS4830WH
4 мм	GS17MAM4840WH	GS30MAM4840WH	GS17MAS4840WH	GS30MAS4840WH
5 мм	–	GS30MAM4850WH	–	GS30MAS4850WH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold GSMABSM / GSMABSS
Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

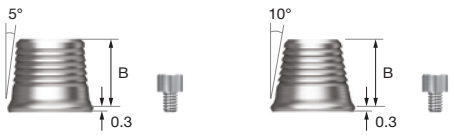Титановые основания Multi Ti Base




Высота	5°	10°
	Ø 4.8	
	Код	
4 мм	TSMTB0405GTH	TSMTB0410GTH*
6 мм	TSMTB0605GTH	–

*Используется для фиксации временных реставраций

Комплектация: Титановое основание Multi Ti Base.
+ Винт для титановых оснований Multi Ti Base (TSMTBS).
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Сканмаркер Multi



Код
TSMSBC

Комплектация: Сканмаркер. Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Винт для титановых оснований Multi Ti Base





Код
TSMTBS

TS система

M Мини R Стандарт

Компоненты абатмента Multi

	Название		Код
	**Цилиндр Esthetic-Low Gold + специальный титановый винт** Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм	Не 6-гран.	MGR100TH
		6-гран.	MGR200TH
	**Пластиковый цилиндр Esthetic-Low + специальный титановый винт** Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм	Не 6-гран.	MEPR100TH
		6-гран.	MEPR200TH
	**Временный цилиндр Esthetic-Low Стандарт + специальный титановый винт** Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм	Не 6-гран.	MTR100TH
		6-гран.	MTR200TH
	**Специальный титановый винт для цилиндра Multi** Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм		MTS200
	**Винт Ebony Gold для абатмента Multi Angled** Рекомендуемый крутящий момент: не более 15 Нсм	Мини	GSMABSM
		Стандарт	GSMABSS
	**Esthetic-Low Слепочный модуль для открытой ложки.** Мини / стандарт ∅ 4.8	Не 6-гран.	MSR100
	Esthetic-Low Слепочный модуль для открытой ложки. Мини / стандарт ∅ 4.8	6-гран.	MSR200* *Под заказ
	**Esthetic-Low Слепочный модуль для закрытой ложки.** Мини / стандарт ∅ 4.8		MTTR100
	**Esthetic-Low Лабораторный аналог** Стандарт ∅ 4.8		MERR300
	**Esthetic-Low Защитный колпачок от полировки** Стандарт ∅ 4.8		MPCR100
	**Защитный колпачок Esthetic**		MHCR100
	**Ручная отвертка Multi**		MAOD
	**Отвертка Multi для физиодиспенсера**		MAMD

CAD/CAM абатменты

Абатмент TS Link для Cerec



Мини		Стандарт	
Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
TSCTBMWH	TSCTBMNWH	TSCTBRWH	TSCTBRNWH

Комплектация: Абатмент + Скан боди + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент:
Мини – не более 20 Нсм | Стандарт – не более 30 Нсм

Модуль для сканирования Scan Post для Cerec



Мини	Стандарт
Код	Код
TSCSPMTH	TSCSPRTH

Комплектация: Scan Post + Лабораторный винт.

CAD/CAM абатменты


Абатмент Pre-Milled



Оборудование	Arum		Zirkonzahn	
Диаметр	∅ 10.0		∅ 10.0	
Платформа	Мини	Стандарт	Мини	Стандарт
6-гран.	TSPM10ARMWH	TSPM10ARRWH	TSPM10ZKMWH	TSPM10ZKRWH
Не 6-гран.	TSPM10ARMNWH	TSPM10ARRNWH	TSPM10ZKMNWH	TSPM10ZKRNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

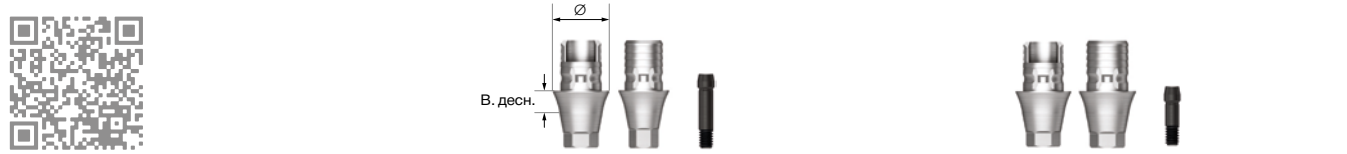
Абатмент TS Link Универсальный



Диаметр		Мини ∅ 4.0		Стандарт ∅ 4.5	
Высота	Высота десны	Код 6-гран.	Код не 6-гран.	Код 6-гран.	Код не 6-гран.
4.0 Закрытый тип	1 мм	TSPL4041CWH	TSPL4041CNWH	TSPL4541CWH	TSPL4541CNWH
	2 мм	TSPL4042CWH	TSPL4042CNWH	TSPL4542CWH	TSPL4542CNWH
	3 мм	TSPL4043CWH	TSPL4043CNWH	TSPL4543CWH	TSPL4543CNWH
	4 мм	TSPL4044CWH	TSPL4044CNWH	TSPL4544CWH	TSPL4544CNWH
4.0 Открытый тип	1 мм	TSPL4041MWH	TSPL4041MNWH	TSPL4541RWH	TSPL4541RNWH
	2 мм	TSPL4042MWH	TSPL4042MNWH	TSPL4542RWH	TSPL4542RNWH
	3 мм	TSPL4043MWH	TSPL4043MNWH	TSPL4543RWH	TSPL4543RNWH
	4 мм	TSPL4044MWH	TSPL4044MNWH	TSPL4544RWH	TSPL4544RNWH
6.0 Закрытый тип	1 мм	TSPL4061MWH	TSPL4061MNWH	TSPL4561RWH	TSPL4561RNWH
	2 мм	TSPL4062MWH	TSPL4062MNWH	TSPL4562RWH	TSPL4562RNWH
	3 мм	TSPL4063MWH	TSPL4063MNWH	TSPL4563RWH	TSPL4563RNWH
	4 мм	TSPL4064MWH	TSPL4064MNWH	TSPL4564RWH	TSPL4564RNWH

Комплектация: Абатмент + Винт Ebony Gold.
Рекомендуемый крутящий момент: ● Мини – не более 20 Нсм | ● Стандарт – не более 30 Нсм

Цифровой лабораторный аналог и компоненты

Название			Код
	Цифровой лабораторный аналог	Мини (TS ∅ 3.0)	TSDLA300
		Мини (TS ∅ 3.5)	TSDLA350
		Стандарт	TSDLA400
	Цифровой лабораторный аналог абатмента TS Multi		TSMDLA
	Расширитель	Мини / Стандарт	DLARDR
	Инструмент для установки цифрового лабораторного аналога		GSDLAPJ
	Инструмент для установки цифрового лабораторного аналога абатмента TS Multi		TSMDLAPJ

Скан Боди



Высота	Мини	Стандарт
	Код	Код
8 мм	TSNSBMSTH	TSNSBRSTH
12 мм	TSNSBMLTH	TSNSBRLTH

Комплектация: Скан Боди + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Нсм

SS система

R Стандарт W Широкий


Имплантат SS III SA (с адаптером)



Высота	Выс. шейки	Диаметр: Стандарт Ø 3.5	Стандарт Ø 4.0	Стандарт Ø 4.5	Широкий Ø 4.5	Широкий Ø 5.0	Широкий Ø 6.0	Широкий Ø 7.0
		Код				Код		
6 мм	2.0	–	–	–	–	ASS3W5006S20	ASS3W6006S20	ASS3W7006S20
7 мм	1.8	–	ASS3R4007S18	ASS3R4507S18		–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W4507S20 *Под заказ	ASS3W5007S20	ASS3W6007S20	ASS3W7007S20
8.5 мм	1.8	ASS3R3508S18	ASS3R4008S18	ASS3R4508S18	–	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W4508S20 *Под заказ	ASS3W5008S20	ASS3W6008S20	ASS3W7008S20
	2.8	ASS3R3508S28	ASS3R4008S28	ASS3R4508S28	–	–	–	–
10 мм	1.8	ASS3R3510S18	ASS3R4010S18	ASS3R4510S18	–	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W4510S20 *Под заказ	ASS3W5010S20	ASS3W6010S20	ASS3W7010S20
	2.8	ASS3R3510S28	ASS3R4010S28	ASS3R4510S28	–	–	–	–
11.5 мм	1.8	ASS3R3511S18	ASS3R4011S18	ASS3R4511S18	–	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W4511S20 *Под заказ	ASS3W5011S20	ASS3W6011S20	ASS3W7011S20
	2.8	ASS3R3511S28	ASS3R4011S28	ASS3R4511S28	–		–	–
13 мм	1.8	ASS3R3513S18	ASS3R4013S18	ASS3R4513S18	–	–	–	–
	2.0	–	–	–	ASS3W4513S20 *Под заказ	ASS3W5013S20	–	–
	2.8	ASS3R3513S28	ASS3R4013S28	ASS3R4513S28	–		–	–

Комплектация: Имплантат + Установочный адаптер + Винт-заглушка.
Рекомендуемый крутящий момент:
Стандарт – не более 40 Нсм
Широкий – не более 40 Нсм

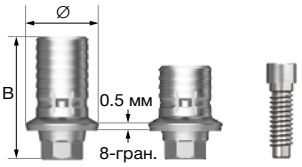Абатмент SS Link Универсальный



Высота	Диаметр: Стандарт Ø 5.1	Широкий Ø 6.3
	Код	Код
4 мм	SSPL4840CTH	SSPL6040CTH
6 мм	SSPL4860CTH	SSPL6060CTH

Комплектация: Абатмент + Винт титановый ComOcta.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм


Абатмент Pre-Milled



ARUM	
Ø 10	
Стандарт	Широкий
SSPM10AGRTH	SSPM10AGWTH
*Под заказ	*Под заказ

Комплектация: Абатмент + Винт титановый ComOcta.
*Для не 8-гран. TH заменить на NTH


Цифровой лабораторный аналог для системы имплантатов SS




Стандарт	Широкий
Код	Код
SSDLA480	SSDLA600

Комплектация: Лабораторный аналог + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Нсм

Скан Боди для системы имплантатов SS





Высота	Стандарт	Широкий
	Код	Код
6 мм	SSNSBRSTH	SSNSBWSTH
10 мм	SSNSBRLTH	SSNSBWLTH

Комплектация: Скан Боди + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Нсм

Формирователь десны для системы имплантатов SS




Диаметр / Высота	Стандарт	Широкий
	∅ 4.8	∅ 6.0
	Код	Код
2 мм	SSH482	–
3 мм	SSH483	SSH603
4 мм	SSH484	SSH604
5 мм	SSH485	SSH605

Лабораторный аналог ComOcta




Стандарт	Широкий
∅ 4.8	∅ 6.0
Код	Код
SSFA480	SSFA600

Слепочный модуль ComOcta для закрытой ложки







Диаметр / Высота	Стандарт		Широкий	
	∅ 4.8		∅ 6.0	
	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
9.5 мм	SSCTIS480	SSCTIS480N*	SSCTIS600	SSCTIS600N*
12.5 мм	SSCTIL480	SSCTIL480N	SSCTIL600	SSCTIL600N*

*Под заказ *Под заказ

Комплектация: Слепочный модуль + Пин.

Слепочный модуль ComOcta для открытой ложки




Стандарт	Широкий
∅ 4.8 | Высота 10	∅ 6.0 | Высота 10
Код 8-гран.	Код 8-гран.
SSICA480	SSICA600

Комплектация: Слепочный модуль + Пин.

Винт титановый ComOcta



Стандарт | Широкий
∅ 4.8 | ∅ 6.0
Код
ASR200

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм

Винт титановый ComOcta Angled




Стандарт | Широкий
∅ 4.8 | ∅ 6.0
Код
ASS200*


*Под заказ

SS система

R Стандарт W Широкий

Абатмент временный титановый ComOcta





Диаметр / Высота десны	Стандарт ∅ 4.8		Широкий ∅ 6.0	
	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
0 мм	SSTAO480TH	SSTAN480TH	SSTAO600TH	SSTAN600TH
2 мм	SSTAO482TH	SSTAN482TH	SSTAO602TH	SSTAN602TH

Комплектация: Абатмент+ Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Абатмент ComOcta для цементной фиксации



Диаметр / Высота	Стандарт ∅ 4.8		Широкий ∅ 6.0	
	Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
4 мм	SSCA484TH	SSCA484NTH	SSCA604TH	SSCA604NTH
5.5 мм	SSCA485TH	SSCA485NTH	SSCA605TH	SSCA605NTH* *Под заказ
7 мм	SSCA487TH	SSCA487NTH	SSCA607TH	SSCA607NTH* *Под заказ

Комплектация: Абатмент + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм

Абатмент ComOcta Angled



Диаметр / Угол	Стандарт ∅ 4.8	Широкий ∅ 6.0
	Код 8-гран.	Код 8-гран.
15°	SSA4815TH	SSA6015TH
20°	SSA4820TH	SSA6020TH

Абатмент Octa для винтовой фиксации



Стандарт	Широкий
∅ 4.8	∅ 6.0
Код	Код
SSOA480	SSOA600

Рекомендуемый крутящий момент: не более 30 Нсм
Фиксируется ключом ODSS, ODSL (стр. 21)

Лабораторный аналог Octa



Стандарт	Широкий
∅ 4.8	∅ 6.0
Код	Код
SSLA480	SSLA600

Слепочный модуль Octa для открытой ложки



Стандарт ∅ 4.8		Широкий ∅ 6.0	
Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
SSICO480	SSICN480* *Под заказ	SSICO600	SSICN600* *Под заказ

Комплектация: Слепочный модуль + Пин.

Слепочный модуль Octa для закрытой ложки



Стандарт	Широкий
∅ 4.8	∅ 6.0
Код	Код
SSOTI480	SSOTI600

Комплектация: Слепочный модуль + Пин.


Винт титановый Octa





Стандарт | Широкий
∅ 4.8 | ∅ 6.0
Код
SSFS


Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Цилиндр пластиковый Octa









Стандарт		Широкий	
∅ 4.8		∅ 6.0	
Код 8-гран.	Код не 8-гран.	Код 8-гран.	Код не 8-гран.
SSPSO480TH	SSPSN480TH	SSPSO600TH	SSPSN600TH* *Под заказ

Комплектация: Цилиндр + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Цилиндр временный титановый Octa







Диаметр / Высота десны	Стандарт	Широкий
	∅ 4.8	∅ 6.0
	Код	Код
0 мм	SSTCO480TH	SSTCO600TH
2 мм	SSTCO482TH	SSTCO602TH

Комплектация: Цилиндр + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Цилиндр комбинированный Octa





Стандарт	Широкий
∅ 4.8	∅ 6.0
Код	Код
SSOCC480TH	SSOCC600TH

Комплектация: Цилиндр + Винт.
Рекомендуемый крутящий момент: не более 20 Нсм

Защитный колпачок Octa







Стандарт	Широкий
∅ 4.8	∅ 6.0
Код	Код
SSHC480TH	SSHC600TH

Комплектация: Колпачок + Винт.

Ключ Octa





Короткий	Длинный
8-гран.	8-гран.
Код	Код
ODSS	ODSL

Используется для абатментов Convertible ∅ 5.0, ∅ 6.0 и для абатментов Octa системы SS

Руководство по протезированию на имплантатах системы SS

OS система

Для установки используется набор Ortho Kit – OOKS


Винт ортодонтический со сквозным отверстием (фрезерованная поверхность)



Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6		Ø 1.8	
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	4 мм	1.5 мм	4 мм
Длина	Код	Код	Код		Код	
6 мм	OSTH1206	OSTH1406	OSTH1606	OSTH16064	OSTH1806	OSTH18064
8 мм	OSTH1208	OSTH1408	OSTH1608	–	OSTH1808	–
10 мм	–	–	OSTH1610	–	OSTH1810	–

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

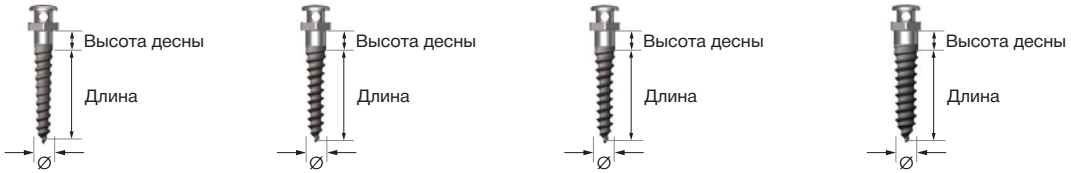Винт ортодонтический со сквозным отверстием (комбинированная поверхность)



Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6 мм	OSTH1206HE	OSTH1406HE	OSTH1606HE	OSTH1806HE
8 мм	OSTH1208HE	OSTH1408HE	OSTH1608HE	OSTH1808HE
10 мм	–	–	OSTH1610HE	OSTH1810HE

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм


Винт ортодонтический с головкой в виде брекета (фрезерованная поверхность)



Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код
6 мм	OSBH1406	OSBH1606	OSBH1806
8 мм	OSBH1408	OSBH1608	OSBH1808
10 мм	–	OSBH1610	OSBH1810

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

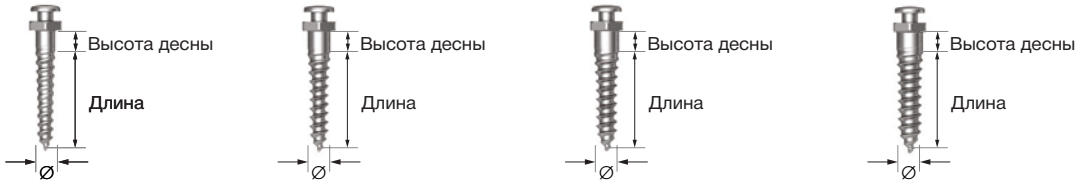
Винт ортодонтический со стандартной головкой (фрезерованная поверхность)



Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6		Ø 1.8	
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	4 мм	1.5 мм	4 мм
Длина	Код	Код	Код		Код	
6 мм	OSSH1206	OSSH1406	OSSH1606	OSSH16064	OSSH1806	OSSH18064
8 мм	OSSH1208	OSSH1408	OSSH1608	–	OSSH1808	–
10 мм	–	–	OSSH1610	–	OSSH1810	–

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

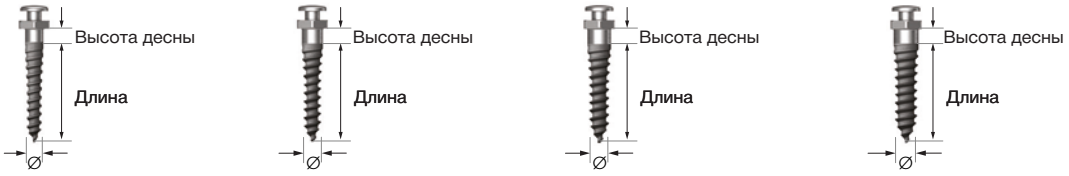Винт ортодонтический со стандартной головкой (комбинированная поверхность)



Диаметр	Ø 1.2	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код	Код
6 мм	OSSH1206HE	OSSH1406HE	OSSH1606HE	OSSH1806HE
8 мм	OSSH1208HE	OSSH1408HE	OSSH1608HE	OSSH1808HE
10 мм	–	–	OSSH1610HE	OSSH1810HE

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.2 мм | Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

Винт ортодонтический с малой головкой (фрезерованная поверхность)



Диаметр	Ø 1.4	Ø 1.6	Ø 1.8
Высота десны	1.5 мм	1.5 мм	1.5 мм
Длина	Код	Код	Код
6 мм	OSSHS1406	OSSHS1606	OSSHS1806
8 мм	OSSHS1408	OSSHS1608	OSSHS1808
10 мм	–	OSSHS1610	OSSHS1810

Рекомендуемый крутящий момент:
Ø 1.4 мм – не более 15 Нсм, Ø 1.6 мм – не более 20 Нсм, Ø 1.8 мм – не более 30 Нсм

MS система

Для установки используется
набор MS Kit – OMSK

Имплантат MS узкий гребень





Диаметр	Ø 2.5		Ø 3.0	
Высота десны	2.5 мм	4 мм	2.5 мм	4 мм
Длина	Код		Код	
10 мм	MSP25103R	MSP25104R	MSP30103R	MSP30104R
11.5 мм	MSP25113R	MSP25114R	MSP30113R	MSP30114R
13 мм	MSP25133R	MSP25134R	MSP30133R	MSP30134R
15 мм	MSP25153R	MSP25154R	MSP30153R	MSP30154R

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 30 Нсм

Слепочный модуль

Код
MSPIC



Лабораторный аналог

Код
MSPLA



Временный колпачок

Код
MSPTC



Имплантат MS временный





Диаметр	Ø 1.8	Ø 2.5
Длина	Код	Код
10 мм	MST18104	MST25104
13 мм	MST18134	MST25134
15 мм	MST18154	MST25154

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 30 Нсм
Возможность наклона шейки до 5°

Временный колпачок (титановый)

Код
MSTPC



Лабораторный аналог

Код
MSTLA



Имплантат MS съёмный





Диаметр	Ø 2.5		Ø 3.0	
Высота десны	2 мм	4 мм	2 мм	4 мм
Длина	Код		Код	
10 мм	MSD25102R	MSD25104R	MSD30102R	MSD30104R
11.5 мм	MSD25112R	MSD25114R	MSD30112R	MSD30114R
13 мм	MSD25132R	MSD25134R	MSD30132R	MSD30134R
15 мм	MSD25152R	MSD25154R	MSD30152R	MSD30154R

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 30 Нсм

Колпачок O-ring

Код
RCS01



Лабораторный аналог

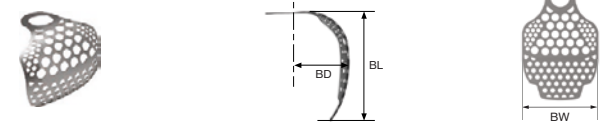
Код
MSDLA



Материалы для НКР


Мембрана титановая OssBuilder OB2

Дефект одной стенки




P	BW	BL	BD	Код
4	8	7	5.5	SM1W487SB
4	10	7	5.5	SM1W4107SB
4	10	9	5.5	SM1W4109SB

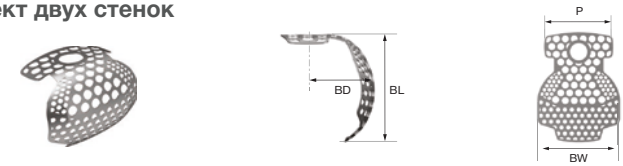Дефект двух стенок



P	BW	BL	BD	Код
7	9	7	5.5	SM2W797SB
7	9	9	5.5	SM2W799SB
10	12	7	5.5	SM2W10127SB
10	12	9	5.5	SM2W10129SB
12	12	7	5.5	SM2W12127SB
12	12	9	5.5	SM2W12129SB

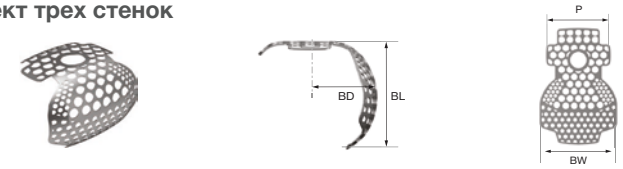
Дефект трех стенок



P	BW	BL	BD	Код
7	9	7	5.5	SM3W797SB
7	9	9	5.5	SM3W799SB
10	12	7	5.5	SM3W10127SB
10	12	9	5.5	SM3W10129SB
12	12	7	5.5	SM3W12127SB
12	12	9	5.5	SM3W12129SB


Мембрана титановая OssBuilder OB3

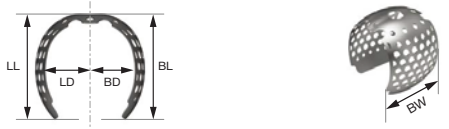Вертикальная аугментация



BW	BL	LL	BD	LD	Код
10	7	7	5.5	5.5	SB3V107F
10	9	9	5.5	5.5	SB3V109F
10	11	11	5.5	5.5	SB3V1011F

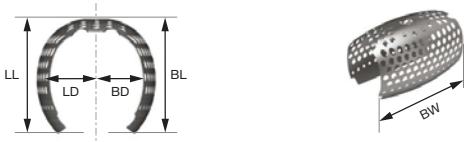
Вертикальная аугментация



BW	BL	LL	BD	LD	Код
20	7	7	5.5	5.5	SB3V207F
20	9	9	5.5	5.5	SB3V209F
20	11	11	5.5	5.5	SB3V2011F*

*Под заказ

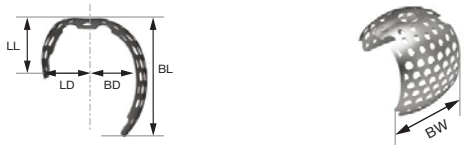Горизонтальная аугментация



BW	BL	LL	BD	LD	Код
10	7	3.5	5.5	3.7	SB3H107F
10	9	4.5	5.5	3.7	SB3H109F
10	11	6	5.5	3.7	SB3H1011F*

*Под заказ

Горизонтальная аугментация




BW	BL	LL	BD	LD	Код
20	7	3.5	5.5	3.7	SB3H207F*
20	9	4.5	5.5	3.7	SB3H209F
20	11	6	5.5	3.7	SB3H2011F


*Под заказ

P = Проксимальный
BW = Ширина с вестибулярной стороны
BL = Высота с вестибулярной стороны
LL = Высота с язычной стороны
BD = Расстояние до вестибулярной стенки
LD = Расстояние до язычной стенки




Материалы для НКР


Винты и пины костные для НКР

	Название	∅	Высота (L)	Код
	**Винт костный** Для установки используется: машинный ключ для костного винта BSCMD Рекомендуемый крутящий момент: до 40 Нсм	1.2 мм	3 мм	BSCH1203
			4 мм	BSCH1204
			5 мм	BSCH1205
		1.4 мм	4 мм	BSCH1404
			6 мм	BSCH1406
			8 мм	BSCH1408
		2.0 мм	8 мм	BSCH2008
			10 мм	BSCH2010
			12 мм	BSCH2012
			14 мм	BSCH2014
			16 мм	BSCH2016


	Название	Длина (L)	Код
	**Пин костный** Фиксируется перкуссионным методом. Устанавливается набором GBR Kit (инструмент отдельно не продается)	3 мм	OBT3







Компоненты мембраны титановой OssBuilder нового типа

	Название	∅	Высота	Код
	**Винт-заглушка** Фиксируется ручной шестигранной отверткой 0.9 (стр. 27) Крутящий момент: не более 5-8 Нсм	4 мм	0.3 мм	SBCC4000
	**Формирователь десны** Фиксируется ручной шестигранной отверткой 0.9 (стр. 27) Крутящий момент: не более 5-8 Нсм	4 мм	3 мм	SBHC4030
			4 мм	SBHC4040
		5 мм	3 мм	SBHC5030
			4 мм	SBHC5040
	**Удлинитель (переходник)** **OB Anchor** Фиксируется ручной шестигранной отверткой 0.9 (стр. 27) Крутящий момент: не более 12-15 Нсм	3.5 мм	0 мм	SBAC3500TSM
			0.5 мм	SBAC3505TSM
			1 мм	SBAC3510TSM
			1.5 мм	SBAC3515TSM
			2.0 мм	SBAC3520TSM
			2.5 мм	SBAC3525TSM
			3.0 мм	SBAC3530TSM
		4.0 мм	0 мм	SBAC4000TSR
			0.5 мм	SBAC4005TSR
			1 мм	SBAC4010TSR
			1.5 мм	SBAC4015TSR
			2.0 мм	SBAC4020TSR
			2.5 мм	SBAC4025TSR
			3.0 мм	SBAC4030TSR

	Название	Длина (L)	Код
	**Винт временный для фиксации (Tenting Screw)** Фиксируется машинной шестигранной отверткой 0.9 (стр. 27)	8.5 мм	SBS2008I
		10 мм	SBS2010I
		11.5 мм	SBS2011I
		13 мм	SBS2013I

Компоненты мембраны титановой OssBuilder старого типа

	Название	Ø	Высота	Код
	**Винт-заглушка** Устанавливается ключом для установки винта-заглушки (код SMCDES/SMCDESS) Крутящий момент: не более 5-8 Нсм	4 мм	1.5 мм	SMCC415
	**Формирователь десны** Фиксируется ручной отверткой (код: AHD12SH/AHD12LH) Крутящий момент: не более 5-8 Нсм	4 мм	3 мм	SMHA443R
			4 мм	SMHA444R
		5 мм	3 мм	SMHA553R
	**Удлинитель для TS (Переходник) Мини** Фиксируется ручной отверткой (код: AHD12SH/AHD12LH)	3.5 мм	0.5 мм	SMHI305TSM
			1 мм	SMHI310TSM
			1.5 мм	SMHI315TSM
			2.0 мм	SMHI320TSM
			2.5 мм	SMHI325TSM
			3.0 мм	SMHI330TSM
	Удлинитель для TS (Переходник) Стандарт Фиксируется ручной отверткой (код: AHD12SH/AHD12LH)	4.0 мм	0.5 мм	SMHI405TSR
			1 мм	SMHI410TSR
			1.5 мм	SMHI415TSR
			2.0 мм	SMHI420TSR
			2.5 мм	SMHI425TSR
			3.0 мм	SMHI430TSR

	Название		Код
	**Ручная отвертка** 0.9 Hex		AHD09LH* *Под заказ
			AHD09SH* *Под заказ
			AHD09MSH* *Под заказ
	**Машинная отвертка** 0.9 Hex		AMSD09L
			AMSD09S
	**Ключ для установки формирователя и винта-заглушки**	Длинный	SMCDES
		Короткий	SMCDESS
	**Инструмент для определения дефектов**		SMDG

Материалы для НКР

Костный ксенотрансплантат

	Название	Объем	Масса	Код
	**Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss** Размер частиц 0.25~1.0 мм	0.5 CC	0.25 г	BAS02
		1.0 CC	0.5 г	BAS05
		2.0 CC	1 г	BAS10
		4.0 CC	2 г	BAS20
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss Размер частиц 1.0~2.0 мм	0.75 CC	0.25 г	BAL02
		1.5 CC	0.5 г	BAL05
		3.0 CC	1 г	BAL10
		6.0 CC	2 г	BAL20

	Название	Размер	Код
	**Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss с добавлением коллагена**	∅ 6.2×8 мм	BAC150B
		∅ 7.2×10 мм	BAC250B

	Название	Объем	Диаметр шприца	Код
	**Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss в шприце** Размер частиц 0.25 ~1.0 мм	0.25 CC	∅ 5.4	BAS02SG54
		0.5 CC		BAS05SG54
		1.0 CC		BAS10SG54
		0.25 CC	∅ 3.5	BAS02SG35
	Минеральный костнозамещающий материал из бычьей кости A-Oss в шприце Размер частиц 1.0 ~ 2.0 мм	0.25 CC	∅ 5.4	BAL02SG54
		0.5 CC		BAL05SG54
		1.0 CC		BAL10SG54

Костный аллотрансплантат

	Название	Объем	Код
	**SureOss Порошок** (кортикальная кость) Размер частиц 200~850 μm	0.25 CC	POWDER025
		0.5 CC	POWDER05
		1 CC	POWDER10
	**SureOss Крошка** (кортикальная кость) Размер частиц 850~1500 μm	0.25 CC	CHIP025
		0.5 CC	CHIP05
		1 CC	CHIP10
	**OsteOss Порошок** (кортикальная + губчатая кость) Размер частиц 200~850 μm	0.25 CC	CCP25
		0.5 CC	CCP50
		1 CC	CCP100
	**OsteOss Крошка** (кортикальная + губчатая кость) Размер частиц 850~1500 μm	0.25 CC	CCC25
		0.5 CC	CCC50
		1 CC	CCC100

Мембрана резорбируемая коллагеновая

	Название	Размер	Код
	**Мембрана Ossguide коллагеновая** (коллаген свиной I класса) Толщина: 0.2 мм	15 мм×20 мм	TG-1
		20 мм×30 мм	TG-2
		30 мм×40 мм	TG-3
	**Мембрана OssMem Soft коллагеновая** (коллаген I класса из бычьего сухожилия) Толщина: 0.35 мм	15 мм×20 мм	OCMS1520
		20 мм×30 мм	OCMS2030
		30 мм×40 мм	OCMS3040
	**Мембрана OssMem Hard коллагеновая** (коллаген I класса из бычьего сухожилия) Толщина: 0.35 мм	15 мм×20 мм	OCMH1520
		20 мм×30 мм	OCMH2030
		30 мм×40 мм	OCMH3040

Бесклеточный дермальный матрикс

	Название	Размер	Код
	**SureDerm** Толщина: 0.25 мм – 0.59 мм	10 мм×20 мм	SUREDERM1012
		10 мм×40 мм	SUREDERM1014
		20 мм×20 мм	SUREDERM1022
		20 мм×40 мм	SUREDERM1024
	**SureDerm** Толщина: 0.60 мм – 0.99 мм	10 мм×20 мм	SUREDERM2012
		10 мм×40 мм	SUREDERM2014
		20 мм×20 мм	SUREDERM2022
		20 мм×40 мм	SUREDERM2024

A-силиконовая слепочная масса




	Название	Упаковка	Код
	**База**	База (Putty) – 400 мл Катализатор – 400 мл	ESS400P

Хирургические наборы


Хирургические протоколы Osstem

Хирургические наборы Osstem

Имплантация



	Название	Код
	**Хирургический набор 122 Taper Kit** (для установки имплантатов TSIII, TSIV, SSIII)	O122TPK
	**НОВИНКА 2026** **Хирургический набор 122 Taper Full Kit** (для установки имплантатов TSIII, TSIV, SSIII + Ultra-Wide)	O122TPFK
	**Хирургический набор 123 Full Kit** (для установки имплантатов TSII, TSIII, SSIII)	O123FK
	**Хирургический набор 485 Kit** (для установки коротких имплантатов)	O485K
	**Хирургический набор MS Kit** (для установки системы MS)	OMSK
	**Хирургический набор Ortho Kit** (для установки ортодонтических винтов)	OOKS

Протезирование


	Название	Код
	**Ортопедический набор Prosthetic Kit** (для протезирования систем TS, SS)	OPK

Хирургические наборы

Навигационная хирургия


	Название	Код
	**Хирургический набор One Guide Kit** (для навигационной хирургии)	OOGK
	**Хирургический набор OneMS Kit** (для установки имплантатов MS и TSIII 3.0 по шаблону)	OOMSK
	**Хирургический набор OneCAS Kit** (для закрытого синус-лифтинга по шаблону)	OOCK
	**Хирургический набор Denture 4U Kit** (для операций по методике All-on-X)	OD4UK
	**Хирургический набор Parallel Guide Advanced Kit** (для позиционирования имплантатов)	OPGAK
	**Хирургический набор Parallel Guide Prime Kit** (для позиционирования имплантатов)	OPGPK

Извлечение имплантата | Извлечение винта




	Название	Код
	**Набор для извлечения имплантата EFR Kit**	OSFRK
	**Набор для извлечения винта из имплантата ESR Kit**	OESRK
	**НОВИНКА 2026** **Набор для чистки при периимплантите IM-Cure Kit**	HICK

Хирургические наборы

Костная пластика


	Название	Код
	**Хирургический набор OssBuilder Kit** (для НКР с титановой мембраной OssBuilder)	HGBRK
	**Хирургический набор GBR Kit** (для НКР с применением костных пинов и костных винтов)	ONGBRK
	**Хирургический набор CAS Kit** (для закрытого синус-лифтинга)	HCRSNK
	**Хирургический набор LAS Kit** (для открытого синус-лифтинга)	HLRSNK
	**НОВИНКА 2026** **Хирургический набор LAS Plus Kit** (для открытого синус-лифтинга) *LAS Kit + кюреты Sinus Kit	HLRSNKP
	**Хирургический набор ESSET Kit** (для расщепления костного гребня)	HESEK
	**Хирургический набор CAS Kit PLUS** (для закрытого синус-лифтинга)	HCRSNKP


Наборы инструментов

	Название	Код
	**Набор хирургических инструментов Osstem Basic Kit** (24 единицы)	OBKIT
	**Набор хирургических инструментов Doctor Cho Kit** (9 единиц)	DCHOKIT
	**Набор хирургических инструментов Sinus Kit для открытого синус-лифтинга** (5 единиц)	ASLK
	**Набор хирургических инструментов Osteo Kit для закрытого синус-лифтинга** (11 единиц)	OSTK
	**Набор хирургических инструментов Bone Spreader Kit для расщепления костного гребня** (4 единицы)	OBSOK
	**Набор хирургических инструментов Split Kit прямой для расщепления костного гребня** (5 единиц)	ORSSK
	**Набор хирургических инструментов Split Kit изогнутый для расщепления костного гребня** (5 единиц)	ORSOK


Инструменты

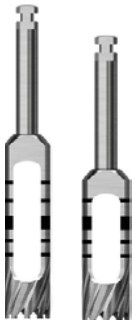Инструменты


	Название	Длина	Код
	**Сверло-трепан** Внутренний ∅ 3.7 | Внешний ∅ 4.5	31 мм	TD37S
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 4.2 | Внешний ∅ 5.0	31 мм	TD42S
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 4.7 | Внешний ∅ 5.5	31 мм	TD47S
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 5.2 | Внешний ∅ 6.0	31 мм	TD52S
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 6.2 | Внешний ∅ 7.0	31 мм	TD62S
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 3.7 | Внешний ∅ 4.5	36.4 мм	TD37
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 4.2 | Внешний ∅ 5.0	36.4 мм	TD42
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 4.7 | Внешний ∅ 5.5	36.4 мм	TD47
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 5.2 | Внешний ∅ 6.0	36.4 мм	TD52
	Сверло-трепан Внутренний ∅ 6.2 | Внешний ∅ 7.0	36.4 мм	TD62

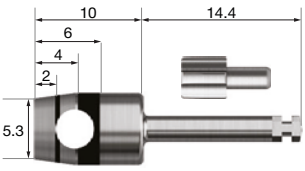	Название	Код
	**Контурный бор (Bone Profiler)** ∅ 4.5 Комплектация: Контурный бор + направляющая M + направляющая R	GSBP45
	**Контурный бор (Bone Profiler)** ∅ 5.5 Комплектация: Контурный бор + направляющая M + направляющая R	GSBP55
	**Контурный бор (Bone Profiler)** ∅ 7.5 Комплектация: Контурный бор + направляющая R	GSBP75
	**Мукотом** Комплектация: Мукотом + Направляющий пин	OSTP53
		OSTP48
		OSTP43
		OSTP33


Инструменты

	Название	Код
	**Кортикальное сверло** F5.5	TCD4C55
	**Кортикальное сверло** F5.0	TCD4C50
	**Кортикальное сверло** F4.5	TCD4C45
	**Кортикальное сверло** F4.0	TCD4C40
	**Кортикальное сверло** F3.5	TCD4C35








Сверло для забора аутокости

	Название	Код
	**Сверло короткое с ограничителем** Ø 5, длина 19	ABC504S
	Сверло длинное с ограничителем Ø 5, длина 22	ABC504L
	Сверло короткое с ограничителем Ø 6, длина 19	ABC604S
	Сверло длинное с ограничителем Ø 6, длина 22	ABC604L
	**Ограничитель под ABC504S** Ø 5, длина 14.5	ABC2ST504S
	Ограничитель под ABC504L Ø 5, длина 17.5	ABC2ST504L
	Ограничитель под ABC604S Ø 6, длина 14.5	ABC2ST604S
	Ограничитель под ABC604L Ø 6, длина 17.5	ABC2ST604L
	**Эжектор кости**	ABBE52L


Инструменты


















Инструменты набора 122 Taper Kit

	Название	L	TL	Код
	**Сверло Taper** F3.5	15 мм	38 мм	122TPD3515*
		13 мм	36 мм	122TPD3513
		11.5 мм	34.5 мм	122TPD3511
		10 мм	34.5 мм	122TPD3510
		8.5 мм	33 мм	122TPD3508
		7 мм	31.5 мм	122TPD3507
		6 мм	30.5 мм	122TPD3506*
	**Сверло Taper** F4.0	15 мм	38 мм	122TPD4015*
		13 мм	36 мм	122TPD4013
		11.5 мм	34.5 мм	122TPD4011
		10 мм	34.5 мм	122TPD4010
		8.5 мм	33 мм	122TPD4008
		7 мм	31.5 мм	122TPD4007
		6 мм	30.5 мм	122TPD4006*
	**Сверло Taper** F4.5	15 мм	38 мм	122TPD4515*
		13 мм	36 мм	122TPD4513
		11.5 мм	34.5 мм	122TPD4511
		10 мм	34.5 мм	122TPD4510
		8.5 мм	33 мм	122TPD4508
		7 мм	31.5 мм	122TPD4507
		6 мм	30.5 мм	122TPD4506*
	**Сверло Taper** F5.0	15 мм	38 мм	122TPD5015*
		13 мм	36 мм	122TPD5013
		11.5 мм	34.5 мм	122TPD5011
		10 мм	34.5 мм	122TPD5010
		8.5 мм	33 мм	122TPD5008
		7 мм	31.5 мм	122TPD5007
		6 мм	30.5 мм	122TPD5006*
	**Сверло Taper** F5.5	15 мм	38 мм	122TPD5515*
		13 мм	36 мм	122TPD5513
		11.5 мм	34.5 мм	122TPD5511
		10 мм	34.5 мм	122TPD5510
		8.5 мм	33 мм	122TPD5508
		7 мм	31.5 мм	122TPD5507
		6 мм	30.5 мм	122TPD5506*
	**Сверло Taper** F6.0	13 мм	36 мм	122TPD6013*
		11.5 мм	34.5 мм	122TPD6011*
		10 мм	34.5 мм	122TPD6010*
		8.5 мм	33 мм	122TPD6008*
		7 мм	31.5 мм	122TPD6007*
		6 мм	30.5 мм	122TPD6006*
	**Сверло Taper** F7.0	13 мм	36 мм	122TPD7013*
		11.5 мм	34.5 мм	122TPD7011*
		10 мм	34.5 мм	122TPD7010*
		8.5 мм	33 мм	122TPD7008*
		7 мм	31.5 мм	122TPD7007*
		6 мм	30.5 мм	122TPD7006*

*не входит в состав набора 122 Taper Kit, приобретается отдельно.




Инструменты набора 122 Taper Kit












	Название	Код
	**Сверло пилотное**	GD2027L
	**Сверло ланцетное**	AGDLC*
	**Сверло боковое**	OSLMD20L*
	**Сверло прямое** ∅ 2.2	2D2213LC01
		2D2211LC01
		2D2210LC01
		2D2208LC01
		2D2207LC01
	**Сверло прямое** ∅ 2.7	3D2715FNLC01
		3D2718FNLC
	**Пин параллельности**	APP2227
	**Пин параллельности Taper**	TPP3522
	**Ключ торка**	TRHD12L
		TRHD12S
	**Имплантовод**	ASMEL
		ASMES

*не входит в состав набора 122 Taper Kit, приобретается отдельно.

Инструменты

















Инструменты набора 122 Taper Kit

	Название		Код
	**Имплантовод машинный**		ASMDL
			ASMDS
	**Инструмент для снятия адаптера**	Мини	ERFM
		Стандарт	HRFR
	**Имплантовод ручной SS**		SSRFDL
			SSRFDS* Под заказ
	**Имплантовод машинный SS**		SSNMDS
	**Имплантовод ручной TS**	Мини	GSMFDL
		Стандарт	GSRFDL
		Мини	GSMFDS* Под заказ
		Стандарт	GSRFDS* Под заказ
	**Имплантовод машинный TS**	Мини	TSNMDML
		Стандарт	TSNMDRL
	**Удлинитель ручного имплантовода**		OTE
	**Удлинитель сверла**		ADE
	**Динамометрический ключ**		TW30B
	**Динамометрический ключ (Spring Type)**		TW30* Под заказ
	**Глубиномер**		OSDG

*не входит в состав набора 122 Taper Kit, приобретается отдельно.
Все артикулы можно заказать отдельно. Артикулы с пометкой «Под заказ» имеют увеличенное время ожидания



Инструменты набора Prosthetic Kit









	Название	Код
	**Ключ торка**	TRHD12E*
		TRHD12L
		TRHD09L* Под заказ
		TRHD12M* Под заказ
		TRHD12S
		TRHD09S* Под заказ
		TRHD12MS*
	**Отвёртка ручная** 1.2 Hex	AHD12EH* Под заказ
		AHD12LH
		AHD12MH* Под заказ
		AHD12SH
		AHD12MSH*
	**Машинная отвертка** 1.2 Hex	AMSD12E* Под заказ
		AMSD12L
		AMSD12S
		OTH12S* Под заказ

*не входит в состав набора Prosthetic Kit, приобретается отдельно.
Все артикулы можно заказать отдельно. Артикулы с пометкой «Под заказ» имеют увеличенное время ожидания

Инструменты











Инструменты набора Prosthetic Kit

	Название	Код
	**Угловой ключ торка для динамометрического ключа Angled Torque Driver**	ATD12L
		ATD12S
	**Отвертка Multi для физиодиспенсера**	MAMD
	**Ручная отвертка Multi**	MAOD
	**Ключ для абатмента Port длинный**	TWLDLK
	**Ключ для абатмента Port короткий**	TWLDSK
	**Ключ абатмента Rigid**	ORDML Под заказ
	**Ключ абатмента Solid**	SDSS
	**Ключ для абатмента O-ring** Используется для абатментов Stud, Convertible ∅ 4.0	AORD
	**Ключ Octa** Используется для абатментов Convertible ∅ 5.0, ∅ 6.0 и для абатментов Octa системы SS	ODSS



Инструменты набора OneGuide Kit














	Название	L	TL	Код
	**Коническое сверло OneGuide** F3.5 (Мягкая кость)	13 мм	39.1 мм	OGTD2213
		11.5 мм	37.6 мм	OGTD2211
		10 мм	36.1 мм	OGTD2210
		8.5 мм	36.1 мм	OGTD2208
		7 мм	36.1 мм	OGTD2207
	**Коническое сверло OneGuide** F3.5	13 мм	39.1 мм	OGTPD3513
		11.5 мм	37.6 мм	OGTPD3511
		10 мм	36.1 мм	OGTPD3510
		8.5 мм	36.1 мм	OGTPD3508
		7 мм	36.1 мм	OGTPD3507
		6 мм	36.1 мм	OGTPD3506* Под заказ
	**Коническое сверло OneGuide** F3.5 (W)	13 мм	39.1 мм	OGTPD3513W Под заказ
		11.5 мм	37.6 мм	OGTPD3511W Под заказ
		10 мм	36.1 мм	OGTPD3510W Под заказ
		8.5 мм	36.1 мм	OGTPD3508W
		7 мм	36.1 мм	OGTPD3507W
		6 мм	36.1 мм	OGTPD3506W* Под заказ
	**Коническое сверло OneGuide** F4.0	13 мм	39.1 мм	OGTPD4013
		11.5 мм	37.6 мм	OGTPD4011
		10 мм	36.1 мм	OGTPD4010
		8.5 мм	36.1 мм	OGTPD4008
		7 мм	36.1 мм	OGTPD4007
		6 мм	36.1 мм	OGTPD4006* Под заказ
	**Коническое сверло OneGuide** F4.5	13 мм	39.1 мм	OGTPD4513
		11.5 мм	37.6 мм	OGTPD4511
		10 мм	36.1 мм	OGTPD4510
		8.5 мм	36.1 мм	OGTPD4508
		7 мм	36.1 мм	OGTPD4507
		6 мм	36.1 мм	OGTPD4506* Под заказ
	**Коническое сверло OneGuide** F4.5 (W)	13 мм	39.1 мм	OGTPD4513W Под заказ
		11.5 мм	37.6 мм	OGTPD4511W Под заказ
		10 мм	36.1 мм	OGTPD4510W Под заказ
		8.5 мм	36.1 мм	OGTPD4508W
		7 мм	36.1 мм	OGTPD4507W
		6 мм	36.1 мм	OGTPD4506W*
	**Коническое сверло OneGuide** F5.0 (W)	13 мм	39.1 мм	OGTPD5013W
		11.5 мм	37.6 мм	OGTPD5011W
		10 мм	36.1 мм	OGTPD5010W
		8.5 мм	36.1 мм	OGTPD5008W
		7 мм	36.1 мм	OGTPD5007W
		6 мм	36.1 мм	OGTPD5006W* Под заказ
	**Коническое сверло OneGuide** F5.5 (W)	13 мм	39.1 мм	OGTPD5513W Под заказ
		11.5 мм	37.6 мм	OGTPD5511W Под заказ
		10 мм	36.1 мм	OGTPD5510W Под заказ
		8.5 мм	36.1 мм	OGTPD5508W Под заказ
		7 мм	36.1 мм	OGTPD5507W
		6 мм	36.1 мм	OGTPD5506W* Под заказ

*не входит в состав набора OneGuide Kit, приобретается отдельно
Все артикулы можно заказать отдельно. Артикулы с пометкой «Под заказ» имеют увеличенное время ожидания

Инструменты



Инструменты набора OneGuide Kit

	Название	Код
	**Имплантовод машинный**	ASMDS
	**Фиксирующий винт**	QGAS18
	**Сверло для фиксирующего винта**	QGATD13
	**Кортикальное сверло OneGuide** F4.5	OGTCD45
	**Направляющее сверло OneGuide** F5.0	OGID2206IW
	**Направляющее сверло OneGuide** F4.5	OGID2206I
	**Направляющее сверло OneGuide** F3.5	OGID2206II
	**Выравнивающее сверло**	OGFD45
	**Имплантовод ручной NoMount** F5.0	OGFDR57
	**Имплантовод ручной NoMount** F4.0/4.5	OGFDR50
	**Имплантовод ручной NoMount** F3.5	OGFDM50
	**Имплантовод под динамометрический ключ OneGuide SS** F4.5	OGFDR50S* Под заказ
	**Имплантовод машинный NoMount** F5.0	OGNMDR57
	**Имплантовод машинный NoMount** F4.0/4.5	OGNMDR50
	**Имплантовод машинный NoMount** F3.5	OGNMDM50
	**Имплантовод под физиодиспенсер OneGuide SS** F4.5	OGNMDR50S*

*не входит в состав набора OneGuide Kit, приобретается отдельно
Все артикулы можно заказать отдельно. Артикулы с пометкой «Под заказ» имеют увеличенное время ожидания

Подбор диаметра и установка имплантата

1. Рекомендуется подбирать диаметр имплантата в зависимости от плотности костной ткани и размера зуба, строго следовать указаниям производителя.

2. В жевательном отделе категорически запрещается ставить имплантаты диаметром 4.0. Рекомендуется использовать имплантаты диаметром от 4.5 и выше.

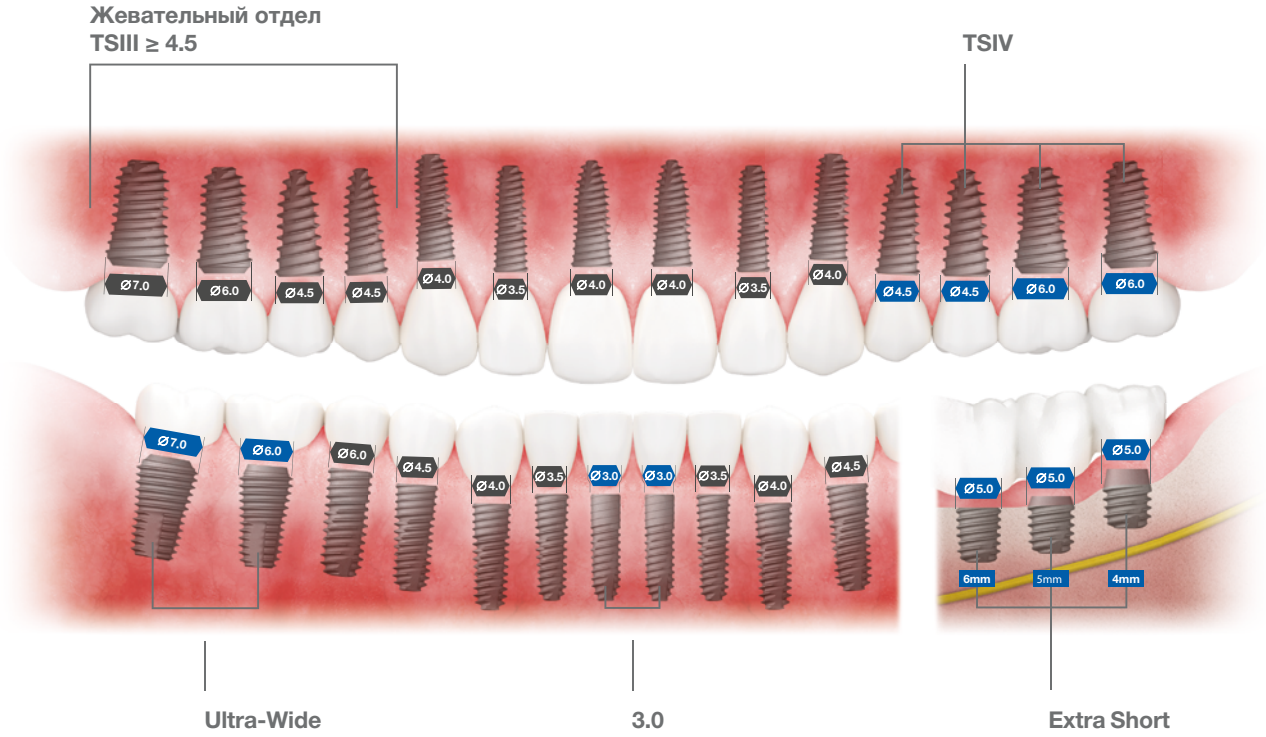
3. При вертикальной атрофии альвеолярного отростка рекомендуется устанавливать имплантаты длиной 6 мм или менее (короткие), либо проведение НКР для установки имплантатов стандартной длины.

4. При дефиците межзубного пространства во фронтальной зоне нижней челюсти рекомендуется устанавливать имплантаты системы TS диаметром 3.0, а также имплантаты системы MS

Внимание!

– Рекомендуемый крутящий момент для TS и SS систем не более 40 Нсм
– Рекомендуемый крутящий момент для MS системы не более 30 Нсм
– Рекомендуемый крутящий момент при фиксации абатментов:
  - Мини не более 20 Нсм
  - Стандарт не более 30 Нсм

Схема



Стоматологическое оборудование

Стоматологическая установка K3

Название	Комплектация	Код
Стоматологическая установка K3 Комплектация №1	Один электрический микромотор	K3MC25A01
Стоматологическая установка K3 Комплектация №2	Два электрических микромотора	K3MC25A01

Комплектация стоматологической установки K3

1. Кресло стоматологическое
- Гидравлический привод
- Подлокотники левый и правый (правый – откидной)
- Подголовник регулируемый
- Защитная функция от придавливания креслом
- Автоматическое отключение перемещений при работе инструментом
- Защитный чехол в ножной части кресла

2. Гидроблок в сборе
- Воздушный эжектор
- Бутыль для дистилированной воды
- Плевательница из закаленного стекла
- Регулировка подачи воды в стаканчик
- Регулировка интенсивности омыва плевательницы
- Подогрев воды для ополаскивания
- Сенсорное наполнение стаканчика
- Возможность подключения к влажной вакуумной системе аспирации
- Возможность доукомплектовать установку сепаратором Durr CS1 для подключения к сухой вакуумной системе аспирации

3. Лампа операционная
- Сенсорное управление
- Плавная регулировка яркости
- Переключаемый жёлтый светофильтр для замедления полимеризации
- Съёмные стерилизуемые рукоятки

4. Столик для врача
- Цветной дисплей для отображения функций и диагностики
- Режим негатоскопа (просмотра снимков)
- Три программируемых положения кресла
- Встроенный таймер
- Резиновый коврик
- Дополнительный столик для инструмента с поддоном из стали
- Дополнительный столик для мыши с подстаканником
- Держатель для бумаг/планшета
- Нижняя подача инструментов
- Индивидуальная регулировка воды на инструменты

5. Столик ассистента
- Функциональная клавиатура
- Столик ассистента с кронштейном для инструментов
- Пылесос
- Слюноотсос
- Трех-функциональный пистолет

6. Многофункциональная ножная педаль
- Управление инструментом нажимаемой клавишей
- Управление положениями кресла джойстиком
- Кнопка положения сплевывания
- Кнопка возврата кресла в предыдущее положение
- Усиленная защита кабеля

7. Консоль Ханаро
- Держатель для салфеток
- Держатель для стаканчиков
- Дополнительный столик

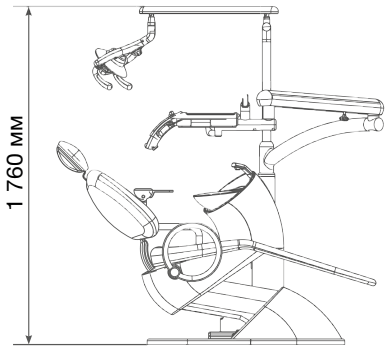
8. Кронштейн для монитора
- Трёхсекционный рычаг
- Проводка для подсоединения монитора к сети
- Проводка для подсоединения монитора к компьютеру
- Антенный кабель

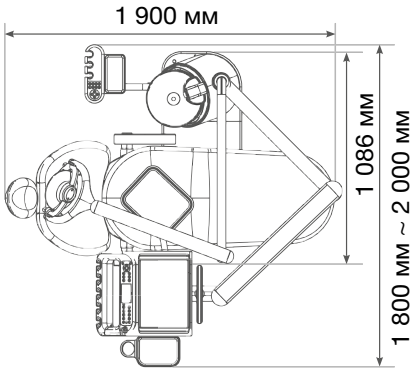
9. Стул врача
- Бесшовная обивка спинки и сиденья в цвет кресла пациента

10. Стул ассистента
- Обивка сиденья в цвет кресла пациента

Стоматологическое оборудование







Комплектация №1*

Один электрический микромотор

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Два шестиканальных шланга Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H510L (NSK)
- Быстросъемный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 2 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трехфункциональный пистолет

Комплектация №2*

Два электрических микромотора

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Один шестиканальный шланг Мидвест
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H310L (NSK)
- Быстросъемный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 1 шт.
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- Трехфункциональный пистолет



Примечание:

- Компрессор не входит в комлектацию
- Аспиратор не входит в комплектацию
- Монитор не входит в комплектацию

*** Цена зависит от комплектации**

Стоматологическое оборудование

НОВИНКА 2026

Стоматологическая установка K5

Название	Комплектация	Код
Стоматологическая установка K5 Верхняя подача, проводная педаль	Один электрический микромотор	K5OSR0160A0A022
	Два электрических микромотора	
Стоматологическая установка K5 Верхняя подача, беспроводная педаль	Один электрический микромотор	K5OSR0160A0A122
	Два электрических микромотора	
Стоматологическая установка K5 Нижняя подача, проводная педаль	Один электрический микромотор	K5OMR0160A0A022 Под заказ
	Два электрических микромотора	
Стоматологическая установка K5 Нижняя подача, беспроводная педаль	Один электрический микромотор	K5OMR0160A0A122 Под заказ
	Два электрических микромотора	

Комплектация стоматологической установки K5

1. Кресло стоматологическое
- Кресло стоматологическое
- Электромеханический привод
- Подлокотники левый и правый (правый – откидной)
- Подголовник регулируемый
- Защитная функция от придавливания креслом
- Автоматическое отключение перемещений при работе инструментом
- Защитный чехол в ножной части кресла
- Управление положениями кресла джойстиком

2. Гидроблок в сборе
- Система промывки инструментальных шлангов
- Воздушный эжектор
- Бутыль для дистиллированной воды
- Поворотная керамическая плевательница
- Регулировка подачи воды в стаканчик
- Регулировка интенсивности омыва плевательницы
- Подогрев воды для ополаскивания
- Сенсорное наполнение стаканчика
- Возможность подключения влажной и сухой аспирации

3. Лампа операционная
- Сенсорное управление
- Плавная регулировка яркости
- Переключаемый жёлтый светофильтр для замедления полимеризации
- Съёмные стерилизуемые рукоятки

4. Столик для врача
- Сенсорный дисплей с расширенным функционалом управления и настроек
- Программируемые настройки для 5-ти операторов
- Встроенный таймер
- Резиновый коврик
- Дополнительный столик для инструмента с поддоном из стали
- Дополнительный столик для мыши с подстаканником
- Держатель для бумаг/планшета
- Индивидуальная регулировка воды на инструменты

5. Столик ассистента
- Функциональная клавиатура
- Столик ассистента с кронштейном для инструментов
- Пылесос
- Слюноотсос
- 3-х функциональный пистолет

6. Многофункциональная ножная педаль
- Управление инструментом поворотной клавишей
- Кнопка положения сплевывания
- Кнопка возврата кресла в предыдущее положение
- Усиленная защита кабеля

7. Консоль Ханаро
- Держатель для салфеток
- Держатель для стаканчиков
- Дополнительный столик

8. Кронштейн для монитора
- Проводка для подсоединения монитора к сети
- Проводка для подсоединения монитора к компьютеру
- Антенный кабель

9. Стул врача
- Бесшовная обивка спинки и сиденья в цвет кресла пациента

10. Стул ассистента
- Бесшовная обивка спинки и сиденья в цвет кресла пациента

11. Комплектация инструментов стола врача
- Три программируемых порога вращения микромотора
- Плавная регулировка оборотов микромотора
- Два 6-ти канальных шланга Мидвест
- Скалер с подсветкой S5L (EMS)
- 3-х функциональный пистолет

Примечание:
- Компрессор не входит в комплектацию
- Аспиратор не входит в комплектацию
- Монитор не входит в комплектацию

Стоматологическое оборудование

Верхняя подача*

1. Один электрический микромотор. Проводная педаль
2. Один электрический микромотор. Беспроводная педаль

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H511L (NSK)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H311L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 2 шт

Верхняя подача*

3. Два электрических микромотора. Проводная педаль
4. Два электрических микромотора. Беспроводная педаль

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H511L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 1 шт



Нижняя подача**

9. Комплектация с подкатным столиком врача
Подробности уточняйте у вашего менеджера

*** Цена зависит от комплектации**

Нижняя подача**

5. Один электрический микромотор. Проводная педаль
6. Один электрический микромотор. Беспроводная педаль

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H511L (NSK)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Mini head H311L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 2 шт

Нижняя подача**

7. Два электрических микромотора. Проводная педаль
8. Два электрических микромотора. Беспроводная педаль

- Бесщеточный электромотор с LED подсветкой MCX (Bien Air)
- Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой Standard head H511L (NSK)
- Быстросъёмный переходник с LED подсветкой CL (NSK) - 1 шт



**** Под заказ**



**** Под заказ**

Стоматологическое оборудование

НОВИНКА 2026

Компьютерный томограф T2 Plus

Название	Комплектация	Код
Компьютерный томограф T2 plus	Компьютерный стоматологический томограф с функцией панорамной съемки	T2-C-P
Компьютерный томограф T2 plus с цефалостатом	Компьютерный стоматологический томограф с функцией панорамной съемки и цефалостатом	T2-CS-P

Комплектация компьютерного стоматологического томографа Osstem T2 Plus

1. Стоматологический томограф Osstem T2 Plus
- Томограф с функцией панорамной съемки в сборе
- Опора томографа
- Набор аксессуаров для позиционирования пациента
- Проводная кнопка экспозиции
- Пульт управления перемещением аппарата по вертикали
- Набор гигиенических чехлов для 2D и 3D исследований
- Комплект соединительных кабелей для компьютера

2. Цефалостат*
- Блок цефалостата с кронштейном в сборе

3. Комплектация рабочей станции
- Мощный системный блок
- Монитор Full HD
- Клавиатура / Мышь
- Программное обеспечение One2
- Программное обеспечение One3

Характеристики программного обеспечения One2 / One3

- Широкий набор функций/фильтров для комфортной диагностики изображений
- Инструменты диагностики ВНЧС
- Предустановленная база имплантатов Osstem
- Удобный планировщик имплантатов
- Возможность установки на дополнительные компьютеры в клинике
- Запись исследований на съемные носители (CD, DVD)
- Русский язык

Примечание:
- Источник бесперебойного питания (ИБП) не входит в комплектацию и приобретается отдельно в соответствии с техническими требованиями к монтажу

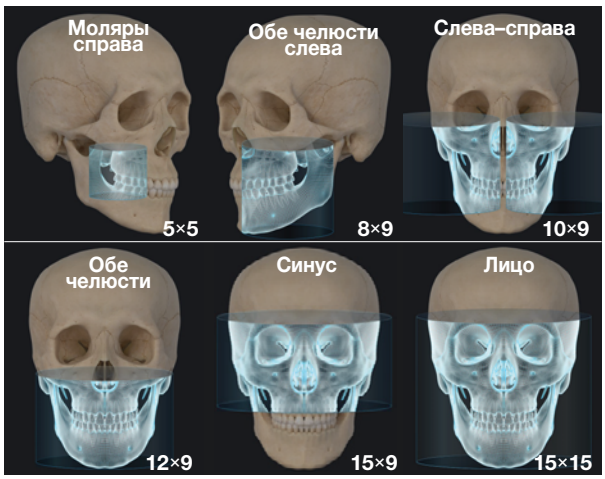
***Опционально (входит в комплектацию T2-CS-P)**

Стоматологическое оборудование

- Максимальная область исследования (FOV) 15x15 см
- Высокое качество снимка: размер вокселя – 0.05 мм
- Эндорежим 5x5
- Metal Artefact Reduction – снижения шумов от металла
- Низкая лучевая нагрузка на пациента
- Рабочая станция (компьютер+монитор) в комплекте
- Гарантия 2 года


Функциональность		КТ + Панорама + Цефалостат
Размер вокселя		от 0.05 мм
Время сканирования	КТ	10 с / 22 с
	Панорама	10 с / 16 с
	Цефалостат	5 с / 9 с
Вес	T2-C-P	190 кг
	T2-CS-P	220 кг

Широкий диапазон FOV




Снижение шумов от металла




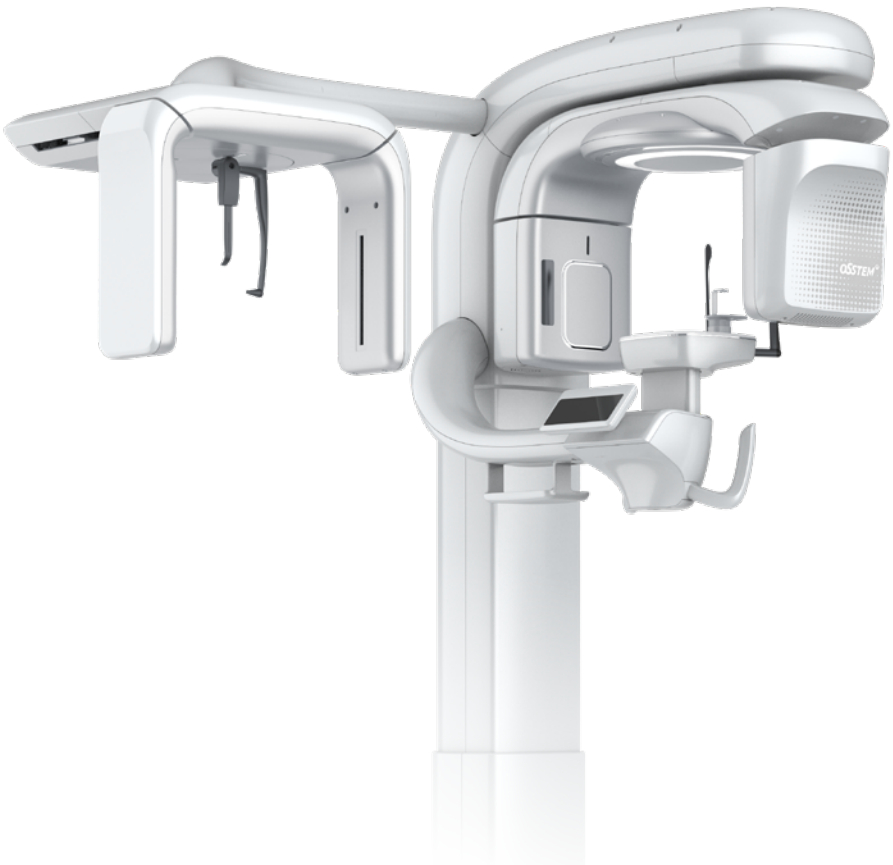

СБОКУ

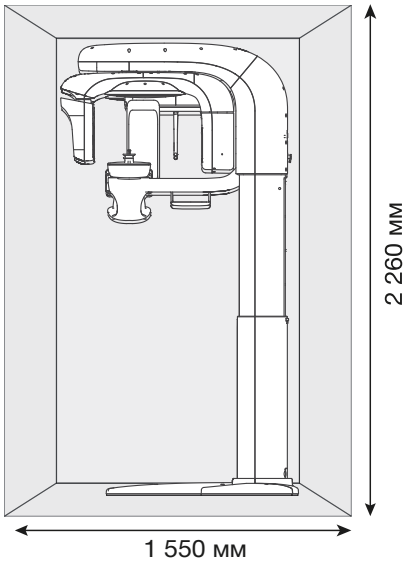

СВЕРХУ

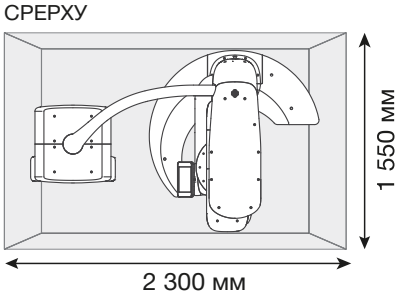

Стоматологическое оборудование

Физиодиспенсеры

	Название	Код
	**Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO 2 OPT** (NSK)	Y1004195
	**Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO** (NSK)	Y1001933
	**Физиодиспенсер SM5** (KAVO)	SM5EN2

Интраоральный сканер

	Название	Код
	**Интраоральный 3D-сканер Medit i700** (Medit)	MD-IS0200

Ирригаторы

	Название	Код
	**Портативный ирригатор Wopick**	WO-200
	**Набор Wopick Combo 2 в 1** (электрическая зубная щётка + ирригатор)	WO-300

Зубные щетки

	Название	Код
	**Зубная щетка для взрослых Vussen Double Wide** (12 шт)	TBA0002
	**Зубная щетка для взрослых Vussen Double Wide** (1 шт)	TBA0001
	**Дорожный набор Vussen** (зубная щётка + зубная паста + дорожный кейс)	TPAA064

Уход за полостью рта

Зубные пасты

	Название	Упаковка	Код
	**Vussen H** (отбеливающая зубная паста)	120 г	TPA0046
	**Vussen W** (отбеливающая зубная паста с фтором)	120 г	TPA0158
	**НОВИНКА 2026** **Vussen 7** (отбеливающая зубная паста)	100 г	TPA0003
	**НОВИНКА 2026** **Vussen 15** (отбеливающая зубная паста)	80 г	TPA0005
	**НОВИНКА 2026** **Vussen 28** (отбеливающая зубная паста)	80 г	TPA0007
	**НОВИНКА 2026** **Vussen 30** (отбеливающая зубная паста)	80 г	TPA0136
	**Vussen S** (зубная паста для чувствительных зубов)	120 г	TPA0093
	**НОВИНКА 2026** **Vussen C** (зубная паста для защиты от кариеса)	120 г	TPA0061

Уход за полостью рта

Зубные пасты

	Название	Упаковка	Код
	НОВИНКА 2026 **Vussen O** (зубная паста для свежести дыхания)	120 г	TPA0140
	НОВИНКА 2026 **Vussen G** (зубная паста для ухода за дёснами)	120 г	TPA0138
	НОВИНКА 2026 **Osstem S** (зубная паста для чувствительных зубов)	120 г	TPA0128
	НОВИНКА 2026 **Osstem G** (зубная паста для ухода за дёснами)	120 г	TPA0126
	НОВИНКА 2026 **Osstem C** (зубная паста для защиты от кариеса)	120 г	TPA0129

Средства для ухода за полостью рта

	Название	Код
	НОВИНКА 2026 **Osstem Zien Solid Gargle** (ополаскиватель для полости рта в виде таблетки)	OGS0001

Обучение

Об учебном центре Osstem OIC

Мы стремимся стать Лучшим Центром Обучения в области дентальной имплантации

- **Тщательно продуманные научные исследования, накопленные знания, лучшие лекторы и систематизированные учебные программы** — все это позволяет учебному центру OIC помогать стоматологам всего мира в их стремлении углубить клинические знания в области имплантологии и проводить безупречное имплантологическое лечение.
- **Учебный центр Osstem OIC в России открыт с 2006 года** и успешно реализует программы обучения, разработаные совместно с международным центром Osstem.
- **Курсы по дентальной имплантации разделены на уровни** — мы приветствуем как опытных имплантологов, которые ищут новые методы работы, так и начинающих специалистов.
- **Наш центр проводит мастер-классы, объясняющие нюансы работы с системой Осстем.**

TRAINING CENTER OIC OSSTEM IMPLANT

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОССТЕМ ИМПЛАНТ

CONTINUING MEDICAL EDUCATION НМО НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный курс аккредитован в системе Непрерывного Медицинского Образования (НМО)



Всем слушателям Osstem OIC выдаются сертификаты о прохождении курсов

Преимущества учебных программ OIC

Сильный лекторский состав

Osstem OIC проводит курсы обучения в каждом уголке мира, собирая ведущих лекторов и предоставляя высоко-профессиональные и систематизированные программы обучения по дентальной имплантации. Врачи получают возможность отработать на практике самые различные навыки при поддержке лучших специалистов-имплантологов.

Акцент на практические занятия

Учебный центр OIC создает все условия, необходимые для качественного обучения:

- аудитория специально оборудована для учебных занятий;
- широкий выбор учебных фантомов позволяет провести практические занятия по всем техникам и методикам, обсуждаемых на курсах.

Реальные операции

Участники курса могут провести операцию на своем пациенте под руководством лектора учебного центра OIC, который обеспечит успешное проведение хирургического этапа лечения.

Поддержка

В нашем центре обучения врачи могут обмениваться опытом и знаниями с лекторами и другими слушателями. Врачи, прошедшие обучение в центре OIC, получают регулярную поддержку даже после окончания курсов.

Международные программы

Центр Osstem OIC в России дает возможность участвовать в международных семинарах, конференциях и мастер-классах, организуя интенсивные курсы обучения в Южной Корее и ежегодные конференции **Osstem World Meeting** в разных странах мира.

Узнайте больше о центре обучения OIC на официальном сайте Osstem в России или у вашего персонального менеджера

Информация

Воспользуйтесь библиотекой Osstem, отсканировав QR-код

Описание систем TS, SS, MS: имплантаты, абатменты и другие компоненты для протезирования

Описание состава хирургических наборов Osstem, применение и параметры инструментов в составе набора

Хирургические протоколы для всех наборов Osstem

Руководство по протезированию на имплантатах системы TS

Руководство по протезированию на имплантатах системы SS

Материалы для НКР

Библиотеки CAD/CAM

Регистрационные удостоверения и Декларации Соответствия Osstem Implant

Присоединяйтесь к нам:



ООО "Осстем" Россия, г. Москва, пр. Андропова 18/7
Тел.: 8-495-739-99-25 I E-mail: info@osstem.ru I www.osstem.ru

Продукция профессионального назначения! Предназначена для использования
в стоматологических медицинских организациях квалифицированным медицинским персоналом